



DELIBERAZIONE N. 0495 DEL

25 MAR. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG4661 del 9.3.2021

Oggetto: "Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, indetta con deliberazione n. 1574 del 21.11.2019".

L'estensore  
Sig.ra Laura Giusti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott.ssa Francesca Milito

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 24/3/2021

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

☒ FAVOREVOLE☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 25.03.2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Vedere "Allegato  
Assunzione Autorizzazione

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data 23/03/2021

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

15.03.2021

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

15.03.2021

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 -2023;

**PREMESSO**

- che con deliberazione n. 1574 del 21.11.2019 è stata formalizzata l'indizione di una di una gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014;
- che con determina dirigenziale n. 473 del 23.7.2020 sono state ammesse le offerte presentate dalle seguenti Ditte:

| Ragione Sociale                   | lotti     |
|-----------------------------------|-----------|
| DEKA M.E.L.A. S.R.L.              | 7         |
| MEDTRONIC ITALIA SPA              | 6         |
| OLYMPUS ITALIA SRL                | 6,8       |
| INVENTIS                          | 1,2,3,4,5 |
| CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO | 11,13,15  |
| STRYKER ITALIA                    | 6         |
| GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.     | 16        |
| LEICA MICROSISTEMS                | 15        |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| GE MEDICAL SYSRTEMS ITALIA S.p.A. | 16                |
| NATUS MEDICAL SRL                 | 1,2,4,5           |
| TEC MED S.r.l.                    | 10,11,12,13,14,15 |
| METALTRONICA                      | 16                |
| DUEFFE 2000 Srl                   | 6,8               |
| GMS MED                           | 16                |
| MEDIKA VISION UNIPERSONALE        | 10,12,13,14       |
| OPTARISTON OFTALMOLOGIA           | 10,11,12,13,14,15 |
| VE.DI.SE. Hospital                | 6,9               |
| BIOPHISICA SRL                    | 10,11,12,13,14    |
| TRADE ART 2000 S.P.A.             | 16                |
| M.R.S Srl                         | 1,2               |

- che con deliberazione n. 1472 del 16.10.2020 è stata nominata la Commissione incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in parola;

- che la Commissione ha terminato i propri lavori il giorno 24.2.2021;

## VISTI

i verbali n. 1, n. 2, e n. 3 relativi alle sedute della Commissione giudicatrice;

## PRESO ATTO

che la Commissione, come risulta dal verbale n. 3, ha proceduto, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste economiche direttamente sul sistema della piattaforma di negoziazione STELLA che ha determinato la graduatoria della procedura di gara come di seguito riportato:

| Lotto | CIG        | Stato                   | Aggiudicatario     | Descrizione                                        |
|-------|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 812485499E | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS           | Audiometro clinico                                 |
| 2     | 8124895B73 | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS           | Impedenzometro clinico                             |
| 3     | 8124939FC1 | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS           | Videonistagmografo                                 |
| 4     | 8124963393 | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS           | Potenziali evocati uditivi                         |
| 5     | 8124973BD1 | Aggiudicazione Proposta | NATUS MEDICAL SRL  | Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione |
| 6     | 812500563B | Aggiudicazione Proposta | OLYMPUS ITALIA SRL | Trapano chirurgico                                 |
| 7     | 8125022443 | Non Giudicabile         |                    | Laser chirurgico                                   |
| 8     | 81250413F1 | Aggiudicazione Proposta | Dueffe 2000 Srl    | Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL       |
| 9     | 8125057126 | Non Giudicabile         |                    | Sistema riunito da visita ORL                      |

|    |            |                         |                                   |                                           |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 10 | 812507934D | Aggiudicazione Proposta | OPTARISTON OFTALMOLOGIA           | Ofthalmoscopio binoculare indiretto       |
| 11 | 8125107A66 | Aggiudicazione Proposta | OPTARISTON OFTALMOLOGIA           | Campimetro                                |
| 12 | 81251405A3 | Aggiudicazione Proposta | BIOPHISICA SRL                    | Ottotipo a proiezione                     |
| 13 | 8125155205 | Aggiudicazione Proposta | Tec Med S.r.l.                    | Frontifocometro                           |
| 14 | 81251849F1 | Aggiudicazione Proposta | MEDIKA VISION UNIPERSONALE        | Autorefrattometro con cheratometria       |
| 15 | 8125198580 | Aggiudicazione Proposta | CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO | Microscopio operatorio                    |
| 16 | 8125215388 | Aggiudicazione Proposta | GE Medical Systems Italia S.p.A.  | Sistema radiologico diretto multifunzione |

**PRESO ATTO**

- che, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere, mediante portale telematico, le spiegazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso alla formulazione delle offerte relative ai lotti n. 6 e n. 16, risultate anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del medesimo Decreto;
- che le Ditte aggiudicatrici dei lotti in parola, hanno inviato i giustificativi, nei termini stabiliti, mediante il Sistema della Piattaforma STELLA;

**VISTO**

l'esito della verifica dei giustificativi presentati, condotta dal RUP, dalla quale risulta che le offerte prodotte dalle Ditte aggiudicatrici dei lotti n. 6 e n. 16 sono da ritenersi congrue ed atte ad evidenziare la congruità dei costi dichiarati nonché tali da fornire ampie garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione della fornitura;

**RITENUTO**

- pertanto opportuno dare conferma della graduatoria definita ad esito dell'apertura delle offerte economiche;
- di aggiudicare la gara a procedura aperta in parola secondo i criteri fissati nel Capitolo Speciale d'Appalto e per i motivi esposti nei suddetti verbali, con le seguenti modalità:

| Lotto | Aggiudicatario | Descrizione                | Importo s/iva |
|-------|----------------|----------------------------|---------------|
| 1     | INVENTIS       | Audiometro clinico         | 17.436,60     |
| 2     | INVENTIS       | Impedenzometro clinico     | 10.710,00     |
| 3     | INVENTIS       | Videonistagmografo         | 14.809,00     |
| 4     | INVENTIS       | Potenziali evocati uditivi | 9.929,60      |

|    |                                   |                                                    |            |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 5  | NATUS MEDICAL SRL                 | Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione | 8.125,00   |
| 6  | OLYMPUS ITALIA SRL                | Trapano chirurgico                                 | 16.968,50  |
| 8  | Dueffe 2000 Srl                   | Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL       | 65.083,88  |
| 10 | OPTARISTON OFTALMOLOGIA           | Oftalmoscopio binoculare indiretto                 | 4.070,00   |
| 11 | OPTARISTON OFTALMOLOGIA           | Campimetro                                         | 31.800,00  |
| 12 | BIOPHISICA SRL                    | Ottotipo a proiezione                              | 5.460,00   |
| 13 | Tec Med S.r.l.                    | Frontifocometro                                    | 7.950,00   |
| 14 | MEDIKA VISION UNIPERSONALE        | Autorefrattometro con cheratometria                | 19.200,00  |
| 15 | CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO | Microscopio operatorio                             | 170.000,00 |
| 16 | GE Medical Systems Italia S.p.A.  | Sistema radiologico diretto multifunzione          | 195.500,00 |

### IMPORTO COMPLESSIVO EURO 577.042,58 + IVA

**PRESO ATTO** che per i Lotti n. 7 e n. 9, non aggiudicati, sarà espletata una nuova procedura di gara;

**CONSIDERATO** che è in corso la verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalle Ditte risultate aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che l'aggiudicazione sarà dichiarata decaduta nel caso i cui si accerti, dai suddetti controlli, che le dichiarazioni presentate dalle Ditte contengano notizie false o mendaci o che i controlli abbiano esito negativo;

**CONSIDERATO** - che l'importo di cui trattasi è complessivamente di Euro 703.991,95 C/IVA e dovrà essere contabilizzato sul piano dei conti di contabilità economico, patrimoniale anno 2021 e sull'aut. n. \_\_\_\_ sub \_\_\_\_ Progetto X002 - fonte di finanziamento - codice di provenienza PROV. 3, con le seguenti modalità:

conto 101020405000 Euro 703.991,95

- che gli esiti della presente aggiudicazione saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta della Unione Europea, e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale, nonché sui seguenti siti internet:

[www.servizicontrattipubblici.it](http://www.servizicontrattipubblici.it),

[www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it);

[www.scamilloforlanini.rm.it/bandi](http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi);

- che, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- che le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante proporzionalmente dalle Ditte aggiudicatrici nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva;

**TENUTO CONTO** che occorre nominare Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Economato Gestione Contratti e Logistica, Dott. Marcello Valensise;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

### PROPONE

- **di aggiudicare** la procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, secondo i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto e per i motivi esposti nei verbali della Commissione, con le seguenti modalità:

| Lotto | Aggiudicatario          | Descrizione                                        | Importo s/iva |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | INVENTIS                | Audiometro clinico                                 | 17.436,60     |
| 2     | INVENTIS                | Impedenzometro clinico                             | 10.710,00     |
| 3     | INVENTIS                | Videonistagmografo                                 | 14.809,00     |
| 4     | INVENTIS                | Potenziali evocati uditivi                         | 9.929,60      |
| 5     | NATUS MEDICAL SRL       | Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione | 8.125,00      |
| 6     | OLYMPUS ITALIA SRL      | Trapano chirurgico                                 | 16.968,50     |
| 8     | Dueffe 2000 Srl         | Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL       | 65.083,88     |
| 10    | OPTARISTON OFTALMOLOGIA | Oftalmoscopio binoculare indiretto                 | 4.070,00      |
| 11    | OPTARISTON OFTALMOLOGIA | Campimetro                                         | 31.800,00     |

|    |                                      |                                              |            |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 12 | BIOPHISICA SRL                       | Ottotipo a proiezione                        | 5.460,00   |
| 13 | Tec Med S.r.l.                       | Frontofocometro                              | 7.950,00   |
| 14 | MEDIKA VISION<br>UNIPERSONALE        | Autorefrattometro con<br>cheratometria       | 19.200,00  |
| 15 | CARL ZEISS S.P.A.<br>CON SOCIO UNICO | Microscopio operatorio                       | 170.000,00 |
| 16 | GE Medical Systems<br>Italia S.p.A.  | Sistema radiologico<br>diretto multifunzione | 195.500,00 |

**IMPORTO COMPLESSIVO EURO 577.042,58 + IVA**

- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in 703.991,95 C/IVA, sul piano dei conti di contabilità economico, patrimoniale anno 2021 e sull'aut. n. \_\_\_\_ sub \_\_\_\_ Progetto X002 - fonte di finanziamento - codice di provenienza PROV. 3, con le seguenti modalità:

conto 101020405000          Euro 703.991,95

- **di approvare** l'avviso di aggiudicazione allegato al presente provvedimento;
- **di pubblicare** gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Gazzetta della Unione Europea e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale, nonché sui seguenti siti internet:  
[www.servizicontrattipubblici.it](http://www.servizicontrattipubblici.it), [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it); [www.scamilloforlanini.rm.it/bandi](http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi);
- **di provvedere**, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- **di disporre** che le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante proporzionalmente dalle Ditte aggiudicatrici nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- **di nominare** Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Economato Gestione Contratti e Logistica, Dott. Marcello Valensise;
- **di corrispondere** il dovuto alle Ditte fornitrici, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE**

**BENI E SERVIZI**

*(Dott. Paolo Farfusola)*

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. n. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTA** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Aggiudicazione della gara a procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, indetta con deliberazione n. 1574 del 21.11.2019." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- **di aggiudicare** la procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, secondo i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto e per i motivi esposti nei verbali della Commissione, con le seguenti modalità:

| Lotto | Aggiudicatario    | Descrizione                                        | Importo s/iva |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | INVENTIS          | Audiometro clinico                                 | 17.436,60     |
| 2     | INVENTIS          | Impedenzometro clinico                             | 10.710,00     |
| 3     | INVENTIS          | Videonistagmografo                                 | 14.809,00     |
| 4     | INVENTIS          | Potenziali evocati uditivi                         | 9.929,60      |
| 5     | NATUS MEDICAL SRL | Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione | 8.125,00      |

|    |                                   |                                              |            |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 6  | OLYMPUS ITALIA SRL                | Trapano chirurgico                           | 16.968,50  |
| 8  | Dueffe 2000 Srl                   | Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL | 65.083,88  |
| 10 | OPTARISTON OFTALMOLOGIA           | Offalmoscopio binoculare indiretto           | 4.070,00   |
| 11 | OPTARISTON OFTALMOLOGIA           | Campimetro                                   | 31.800,00  |
| 12 | BIOPHISICA SRL                    | Ottotipo a proiezione                        | 5.460,00   |
| 13 | Tec Med S.r.l.                    | Frontofocometro                              | 7.950,00   |
| 14 | MEDIKA VISION UNIPERSONALE        | Autorefrattometro con, cheratometria         | 19.200,00  |
| 15 | CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO | Microscopio operatorio                       | 170.000,00 |
| 16 | GE Medical Systems Italia S.p.A.  | Sistema radiologico diretto multifunzione    | 195.500,00 |

**IMPORTO COMPLESSIVO EURO 577.042,58 + IVA**

- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in 703.991,95 C/IVA, sul piano dei conti di contabilità economico, patrimoniale anno 2021 e sull'aut. n. \_\_\_\_ sub \_\_\_\_ Progetto X002 - fonte di finanziamento - codice di provenienza PROV. 3, con le seguenti modalità:

conto 101020405000          Euro 703.991,95

- **di approvare** l'avviso di aggiudicazione allegato al presente provvedimento;
- **di pubblicare** gli esiti della presente aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Gazzetta della Unione Europea e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale, nonché sui seguenti siti internet:  
[www.servizicontrattipubblici.it](http://www.servizicontrattipubblici.it), [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it); [www.scamilloforlanini.rm.it/bandi](http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi);
- **di provvedere**, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- **di disporre** che le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante proporzionalmente dalle Ditte aggiudicatrici nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- **di nominare** Responsabile del Procedimento il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Economato Gestione Contratti e Logistica, Dott. Marcello Valensise;

- **di corrispondere** il dovuto alle Ditte fornitrici, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 88 pagine di cui n. 17 pagine di allegati nei termini indicati.

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

*(D.ssa Francesca Milito)*



**Titolo:** Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, e numero registro di sistema: PI006244-19

**Offerta Economica - Lotto Numero:16**

| Lotto | Voce | CIG        | DESCRIZIONE LOTTO                         | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UNIVA ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) |
|-------|------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 16    | 0    | 8125215388 | Sistema radiologico diretto multifunzione | BN33111000-1     | Apparecchi radiologici       | UNITA                 | 1         | 200.153,45                                | 195.500,00                                | 195.500,00              | 1.380,15                                  |

**VALORE OFFERTA DEL LOTTO 16: 195.500,00 €**

**Ragione sociale del Concorrente:** GE Medical Systems Italia S.p.A.

Via Galeno n. 36 - 20126 Milano (Milano)

C.F. 93027710016 P.IVA IT03663500969

**Antonio Spera**  
**Firmato digitalmente**

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, e numero registro di sistema: PI006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:15

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO      | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE               | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UNITA' (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15         | 018125198580 | Microscopio operatorio | BN33162000-3     | Apparecchi e strumenti per sala operatoria | UNITA                 | 2         | 200.000,00                                | 85.000,00                          | 170.000,00              | 1.660,00                                  | <div> <div></div> <div>All.3_ Schema di Offerta economica (Apparecchiature elettromedicali) LOTTO 15.pdf.p7m</div> </div> 6473D8F341E3DA5497D1337A04FA6097CB26E96764D08F593AB6A398F48A1F03 |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 15: 170.000,00 €

Ragione sociale del Concorrente: CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO

VIA VARESINA 162 - 20156 Milano (Milano)

C.F. 00721920155 P.IVA IT00721920155

BRUNO IZZO  
Firmato digitalmente

**Offerta Economica - Lotto Numero:14**[illegible]

Via Duccio di Buoninsegna, 47 - 00142 ROMA (Roma)  
C.F. 10580671005 P.IVA IT10580671005

**Maurizio Mingo**  
**Firmato digitalmente**

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

TITOLO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: PI006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:13

| Lotto | Voce | CIG        | DESCRIZIONE LOTTO | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                                                                            |
|-------|------|------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13    | 0    | 8125155205 | Frontifocometro   | BN33124100-6     | Apparecchi diagnostici       | UNITA                 | 5         | 10.000,00                                 | 1.590,00                                   | 7.950,00                | 79,50                                     | <div> <div></div> <div>All.3_Schema di Offerta economica Lotto 13.pdf.p7m</div> </div> <div>34BCC00D3331264E2C9A02A7BCCC3C3E8BD162E55FE83FD381E04B41DBB5C0592</div> |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 13: 7.950,00 €

Ragione sociale del Concorrente: Tec Med S.r.l.

Via Ilaria Alpi n. 4 - 00188 ROMA (Roma)

C.F. 06859310580 P.IVA IT01632541007

Stefano Pascale  
Firmato digitalmente

15

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

TITOLO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: P1006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:11

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UMIVA ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                  |
|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | 0 8125107A66 | Campimetro        | BN33124100-6     | Apparecchi diagnostici       | UNITA                 | 2         | 40.000,00                                 | 15.900,00                                 | 31.800,00               | 30,00                                     | 4% Offerta Economica Lotto 11.rar.p7m<br>8CD6619A21CF86C658853A32914FAEEABD1E412BFE8CF2D470E788AA4A6F4D2A |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 11: 31.800,00 €

Ragione sociale del Concorrente: OPTARISTON OFTALMOLOGIA

VIA MODENA 26 - 00184 ROMA (Roma)

C.F. 03751551007 P.IVA IT03751551007

Enma Taborro  
Firmato digitalmente

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: PI006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:10

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO                  | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE  | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                               |
|------------|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | 0 812507934D | Offalmoscopio binoculare Indiretto | BN33122000-1     | Attrezzature per oftalmologia | UNITA                 | 2         | 5.000,00                                  | 2.035,00                                   | 4.070,00                | 4,00                                      | Offerta Economica Lotto 10.rar.p7m<br>B4A60A895934ADD489BDA17AF06E02F318E46E9D95945978247AD60E953798A9 |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 10: 4.070,00 €

Ragione sociale del Concorrente: OPTARISTON OFTALMOLOGIA

VIA MODENA 26 - 00184 ROMA (Roma)

C.F. 03751551007 P.IVA IT03751551007

Emma Taborro  
Firmato digitalmente

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: P1006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:8

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO                            | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALOREA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                            |
|------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8          | 0 81250413F1 | Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL | BN33124100-6     | Apparecchi diagnostici       | UNITA                 | 1         | 70.000,00                                | 65.083,88                                  | 65.083,88               | 240,00                                    | All. 3 Schema offerta economica lotto 8.pdf.p7m<br>8D82EB4381754EE3C55C1C8A83BDC4B42C39F81FEA7665479B421674170FB15E |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 8: 65.083,88 €

Ragione sociale del Concorrente: Dueffe 2000 Srl  
Via Borghetto Madonna del Pozzo, 7 - 00136 ROMA (Roma)  
C.F. 05704371003 P.IVA IT05704371003

Flavia Guerani  
Firmato digitalmente

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: PI006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:6

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO  | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                               |
|------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6          | 0 812500563B | Trapano chirurgico | BN33169000-2     | Strumenti chirurgici         | UNITA                 | 1         | 19.000,00                                 | 16.968,50                                  | 16.968,50               | 169,68                                    | All.3_ Schema di Offerta economica LOTTO 6.pdf.p7m<br>3BE55527A6B13B76EB29E5E153557C4E7F7B3623472EC3A196799EAD6A339316 |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 6: 16.968,50 €

Ragione sociale del Concorrente: OLYMPUS ITALIA SRL

VIA MODIGLIANI 45 - 20090 Segrate (Milano)

C.F. 10994940152 P.IVA IT10994940152

GIANFRANCO GHIONNA  
Firmato digitalmente

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

TITOLO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: PI006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:5

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO                                  | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALOREA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5          | 0 8124973BD1 | Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione | BN33124100-6     | Apparecchi diagnostici       | UNITA                 | 1         | 10.000,00                                | 8.125,00                                   | 8.125,00                | 50,00                                     |  Lotto 5_Schema di Offerta economica.pdf.p7m<br>08F90D88FE971D8650CB257FE6A84DA7492DB142F368D2CE409705A535E6D07B |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 5: 8.125,00 €

Ragione sociale del Concorrente: NATUS MEDICAL SRL

Via Del Commercio 27 - 35036 Montegrotto Terme (Padova)

C.F. 05025030288 P.IVA IT05025030288

Fabio Gomiero  
Firmato digitalmente

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

TITOLO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: P1006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:4

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO          | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALOREA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec. ) | PREZZO OFFERTO PER UMIVA ESCLUSA ( 2 dec. ) | VALORE OFFERTO ( 2 dec. ) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA ( 2 dec. ) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | 0 8124963393 | Potenziali evocati uditivi | BN33124100-6     | Apparecchi diagnostici       | UNITA                 | 1         | 10.000,00                                  | 9.929,60                                    | 9.929,60                  | 40,00                                       |  Lotto_4_All.3_ Schema di Offerta economica (Apparecchiature elettromedicali).pdf.p7m<br>34C072A7D8E58C1BC350B3B5D97C15D126B00569EEEECAD95A686216AF2CB34DF |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 4: 9.929,60 €

Ragione sociale del Concorrente: INVENTIS  
CORSO STATI UNITI, 1/3 - 35127 Padova (Padova)  
C.F. 03957810280 P.IVA IT03957810280

MASSIMO MARTINELLI  
Firmato digitalmente

22

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

TITOLO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: P1006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:2

| Lotto Voce | CIG          | DESCRIZIONE LOTTO      | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                                                                                           |
|------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2          | 0 8124895B73 | Impedenzometro clinico | BN33124100-6     | Apparecchi diagnostici       | UNITA                 | 2         | 12.000,00                          | 5.355,00                                   | 10.710,00               | 43,00                                     | <div>  Lotto_2_All.3_Schema di Offerta economica (Apparecchiature elettromedicali).pdf.p7m </div> |
|            |              |                        |                  |                              |                       |           |                                    |                                            |                         |                                           | E4997534A7B8DC6A6D5161AD5C9C348590D8DE7B8453CDC64A9943617923E141                                                                                                                   |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 2: 10.710,00 €

Ragione sociale del Concorrente: INVENTIS

CORSO STATI UNITI, 1/3 - 35127 Padova (Padova)

C.F. 03957810280 P.IVA IT03957810280

MASSIMO MARTINELLI  
Firmato digitalmente

STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: A.O. San Camillo Forlanini

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini.  
Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014. e numero registro di sistema: P1006244-19

Offerta Economica - Lotto Numero:1

| Lotto | Voce         | CIG | DESCRIZIONE LOTTO  | CODICE REGIONALE | DESCRIZIONE CODICE REGIONALE | UM OGGETTO INIZIATIVA | QUANTITA' | VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.) | PREZZO OFFERTO PER UMIVA ESCLUSA (2 dec.) | VALORE OFFERTO (2 dec.) | ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.) | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------|-----|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 812485499E |     | Audiometro clinico | BN33121400-8     | Audiometri                   | UNITA                 | 3         | 18.000,00                                 | 5.812,20                                  | 17.436,60               | 70,00                                     |  Lotto_1_All.3_Schema di Offerta economica (Apparecchiature elettromedicali).pdf.p7m<br>58D2B79205C60EA6D425CF319514057528022988E7DB30F84EF5064F36745423 |

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 17.436,60 €

Ragione sociale del Concorrente: INVENTIS

CORSO STATI UNITI, 1/3 - 35127 Padova (Padova)

C.F. 03957810280 P.IVA IT03957810280

MASSIMO MARTINELLI  
Firmato digitalmente

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
*Ufficio acquisizione attrezzature – beni - comodati*

**Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014.**

### VERBALE N. 3

Il giorno 24.2.2021 alle ore 10,30, presso i locali della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, la Commissione tecnica, nominata con deliberazione n. 1472 del 16.10.2020, si riunisce in seduta pubblica attivata in modalità virtuale attraverso la Piattaforma STELLA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), per la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica e per l'apertura delle offerte economiche presentate dalle Ditte partecipanti alla gara a Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, indetta con deliberazione n. 1574 del 21.11.2020.

La Commissione riunita è così composta:

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE | Dott. Alberto Rocco – Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria                         |
| COMPONENTE | Dott. Ottavio Bonati – Dirigente Medico U.O.S.D. Oculistica                                |
| COMPONENTE | Dott. Michele Galluzzo – Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini in urgenza ed emergenza |

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Laura Giusti – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente apre la seduta comunicando in modalità virtuale, alle ditte concorrenti, l'esito della valutazione tecnica delle offerte presentate, così come riportato nel prospetto riepilogativo allegato al verbale n. 2. 


Come riportato nel verbale n. 2, le seguenti offerte non sono ammesse alla fase successiva:

Lotto n. 1 – Ditta M.R.S. S.r.l. – offerta non valutabile


Lotto n. 2 – Ditta M.R.S. S.r.l. – offerta non valutabile

Lotto n. 5 – Ditta INVENTIS S.r.l. – punteggio di qualità 33, inferiore alla soglia minima richiesta di 42 punti.

Lotto n. 7 – Ditta DEKA MELA S.r.l. – punteggio di qualità 38,50, inferiore alla soglia minima richiesta di 42 punti.

Lotto n. 9 – Ditta VE.DI.SE HOSPITAL S.p.A. – punteggio di qualità 40,37, inferiore alla soglia minima richiesta di 42 punti. 

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 – 2589 – fax: 06 55552603  


26

Lotto n. 13 – Ditta MEDIKA VISION S.r.l. – punteggio di qualità 37,05, inferiore alla soglia minima richiesta di 42 punti.

Lotto n. 15 – Ditta TEC MED S.r.l. – punteggio di qualità 40,37 e Ditta OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.r.l. – punteggio di qualità 39,34, inferiori alla soglia minima richiesta di 42 punti.

Dopo aver terminato la fase di valutazione tecnica, si procede con l'apertura delle offerte economiche direttamente sulla Piattaforma STELLA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio).

Il punteggio relativo al prezzo offerto da ciascuna Ditta viene calcolato automaticamente dal sistema della suddetta Piattaforma (all. 1), che determina l'aggiudicazione provvisoria con le seguenti modalità:

| Lotto | CIG        | Stato                   | Aggiudicatario             | Descrizione                                        | Numero Offerte Pervenute |
|-------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 812485499E | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS                   | Audiometro clinico                                 | 3                        |
| 2     | 8124895B73 | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS                   | Impedenzometro clinico                             | 3                        |
| 3     | 8124939FC1 | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS                   | Videonistagmografo                                 | 1                        |
| 4     | 8124963393 | Aggiudicazione Proposta | INVENTIS                   | Potenziali evocati uditivi                         | 2                        |
| 5     | 8124973BD1 | Aggiudicazione Proposta | NATUS MEDICAL SRL          | Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione | 2                        |
| 6     | 812500563B | Aggiudicazione Proposta | OLYMPUS ITALIA SRL         | Trapano chirurgico                                 | 5                        |
| 7     | 8125022443 | Non Giudicabile         |                            | Laser chirurgico                                   | 1                        |
| 8     | 81250413F1 | Aggiudicazione Proposta | Dueffe 2000 Srl            | Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL       | 2                        |
| 9     | 8125057126 | Non Giudicabile         |                            | Sistema riunito da visita ORL                      | 1                        |
| 10    | 812507934D | Aggiudicazione Proposta | OPTARISTON OFTALMOLOGIA    | Oftalmoscopio binoculare indiretto                 | 4                        |
| 11    | 8125107A66 | Aggiudicazione Proposta | OPTARISTON OFTALMOLOGIA    | Campimetro                                         | 4                        |
| 12    | 81251405A3 | Aggiudicazione Proposta | BIOPHISICA SRL             | Ottotipo a proiezione                              | 4                        |
| 13    | 8125155205 | Aggiudicazione Proposta | Tec Med S.r.l.             | Frontifocometro                                    | 5                        |
| 14    | 81251849F1 | Aggiudicazione Proposta | MEDIKA VISION UNIPERSONALE | Autorefrattometro con cheratometria                | 4                        |

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

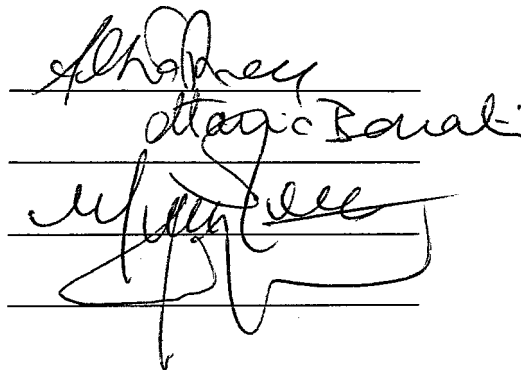
*Forlani*

|    |            |                            |                                         |                                              |   |
|----|------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| 15 | 8125198580 | Aggiudicazione<br>Proposta | CARL ZEISS<br>S.P.A. CON<br>SOCIO UNICO | Microscopio operatorio                       | 4 |
| 16 | 8125215388 | Aggiudicazione<br>Proposta | GE Medical<br>Systems Italia<br>S.p.A.  | Sistema radiologico diretto<br>multifunzione | 5 |

Il Presidente alle ore 12,20 termina la seduta pubblica virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE      Dott. Alberto Rocco  
COMPONENTE      Dott. Ottavio Bonati  
COMPONENTE      Dott. Michele Galluzzo  
SEGRETARIO      Sig.ra Laura Giusti



Four handwritten signatures are present, each on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the President and the three board members listed on the left.

| Numero Lotto | Stato Lotto | Fornitore            | Stato Offerta           | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Valore Offerta |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1            | Valutato    | INVENTIS             | Aggiudicatario proposto | 1    | 87,21            | 57,25             | 29,96               | 17.436,60      |
| 1            | Valutato    | NATUS MEDICAL SRL    | II Classificato         | 2    | 81,50            | 51,50             | 30,00               | 17.414,34      |
| 2            | Valutato    | INVENTIS             | Aggiudicatario proposto | 1    | 86,37            | 56,37             | 30,00               | 10.710,00      |
| 2            | Valutato    | NATUS MEDICAL SRL    | II Classificato         | 2    | 80,88            | 52,75             | 28,13               | 11.420,44      |
| 3            | Valutato    | INVENTIS             | Aggiudicatario proposto | 1    | 82,50            | 52,50             | 30,00               | 14.809,00      |
| 4            | Valutato    | INVENTIS             | Aggiudicatario proposto | 1    | 90,48            | 60,87             | 29,61               | 9.929,60       |
| 4            | Valutato    | NATUS MEDICAL SRL    | II Classificato         | 2    | 73,50            | 43,50             | 30,00               | 9.800,00       |
| 5            | Valutato    | NATUS MEDICAL SRL    | Aggiudicatario proposto | 1    | 77,75            | 47,75             | 30,00               | 8.125,00       |
| 6            | Valutato    | OLYMPUS ITALIA SRL   | Aggiudicatario proposto | 1    | 91,60            | 64,25             | 27,35               | 16.968,50      |
| 6            | Valutato    | MEDTRONIC ITALIA SPA | II Classificato         | 2    | 91,37            | 66,00             | 25,37               | 18.297,40      |
| 6            | Valutato    | VE.DI.SE. Hospital   |                         | 3    | 89,00            | 59,00             | 30,00               | 15.471,00      |
| 6            | Valutato    | STRYKER ITALIA       |                         | 4    | 87,90            | 60,00             | 27,90               | 16.633,60      |
| 6            | Valutato    | Dueffe 2000 Srl      |                         | 5    | 87,80            | 60,50             | 27,30               | 16.998,00      |
| 8            | Valutato    | Dueffe 2000 Srl      | Aggiudicatario proposto | 1    | 90,48            | 60,49             | 29,99               | 65.083,88      |
| 8            | Valutato    | OLYMPUS ITALIA SRL   | II Classificato         | 2    | 85,24            | 55,24             | 30,00               | 65.070,00      |

ALV

| Numero Lotto | Stato Lotto | Fornitore                            | Stato Offerta           | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Valore Offerta |
|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 10           | Valutato    | OPTARISTON<br>OFTALMOLOGIA           | Aggiudicatario proposto | 1    | 83,26            | 54,37             | 28,89               | 4.070,00       |
| 10           | Valutato    | BIOPHISICA SRL                       | Il Classificato         | 2    | 81,30            | 57,00             | 24,30               | 4.840,00       |
| 10           | Valutato    | Tec Med S.r.l.                       |                         | 3    | 80,27            | 50,87             | 29,40               | 4.000,00       |
| 10           | Valutato    | MEDIKA VISION<br>UNIPERSONALE        |                         | 4    | 75,50            | 45,50             | 30,00               | 3.920,00       |
| 11           | Valutato    | OPTARISTON<br>OFTALMOLOGIA           | Aggiudicatario proposto | 1    | 81,75            | 59,74             | 22,01               | 31.800,00      |
| 11           | Valutato    | Tec Med S.r.l.                       | Il Classificato         | 2    | 76,32            | 46,32             | 30,00               | 23.330,00      |
| 11           | Valutato    | BIOPHISICA SRL                       |                         | 3    | 72,26            | 45,75             | 26,51               | 26.400,00      |
| 11           | Valutato    | CARL ZEISS S.P.A.<br>CON SOCIO UNICO |                         | 4    | 67,90            | 50,18             | 17,72               | 39.500,00      |
| 12           | Valutato    | BIOPHISICA SRL                       | Aggiudicatario proposto | 1    | 81,99            | 54,30             | 27,69               | 5.460,00       |
| 12           | Valutato    | Tec Med S.r.l.                       | Il Classificato         | 2    | 80,54            | 52,23             | 28,31               | 5.340,00       |
| 12           | Valutato    | OPTARISTON<br>OFTALMOLOGIA           |                         | 3    | 76,95            | 46,95             | 30,00               | 5.040,00       |
| 12           | Valutato    | MEDIKA VISION<br>UNIPERSONALE        |                         | 4    | 75,60            | 46,30             | 29,30               | 5.160,00       |
| 13           | Valutato    | Tec Med S.r.l.                       | Aggiudicatario proposto | 1    | 84,57            | 54,57             | 30,00               | 7.950,00       |
| 13           | Valutato    | OPTARISTON<br>OFTALMOLOGIA           | Il Classificato         | 2    | 81,16            | 57,19             | 23,97               | 9.950,00       |
| 13           | Valutato    | CARL ZEISS S.P.A.<br>CON SOCIO UNICO |                         | 3    | 76,21            | 51,87             | 24,34               | 9.800,00       |
| 13           | Valutato    | BIOPHISICA SRL                       |                         | 4    | 73,05            | 44,83             | 28,22               | 8.450,00       |

*Real*  
*Bonati*

*10/11/11*

| Numero Lotto | Stato Lotto | Fornitore                              | Stato Offerta           | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Valore Offerta |
|--------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 14           | Valutato    | MEDIKA VISION<br>UNIPERSONALE          | Aggiudicatario proposto | 1    | 78,89            | 48,89             | 30,00               | 19.200,00      |
| 14           | Valutato    | Tec Med S.r.l.                         | II Classificato         | 2    | 75,43            | 50,44             | 24,99               | 23.050,00      |
| 14           | Valutato    | OPTARISTON<br>OFTALMOLOGIA             |                         | 3    | 74,88            | 51,37             | 23,51               | 24.500,00      |
| 14           | Valutato    | BIOPHISICA SRL                         |                         | 4    | 74,76            | 50,25             | 24,51               | 23.500,00      |
| 15           | Valutato    | CARL ZEISS S.P.A.<br>CON SOCIO UNICO   | Aggiudicatario proposto | 1    | 90,86            | 60,86             | 30,00               | 170.000,00     |
| 15           | Valutato    | LEICA<br>MICROSYSTEMS                  | II Classificato         | 2    | 83,38            | 57,85             | 25,53               | 199.800,00     |
| 16           | Valutato    | GE Medical<br>Systems Italia<br>S.p.A. | Aggiudicatario proposto | 1    | 86,60            | 61,94             | 24,66               | 195.500,00     |
| 16           | Valutato    | TRADE ART 2000<br>S.P.A.               | II Classificato         | 2    | 85,57            | 56,53             | 29,04               | 166.000,00     |
| 16           | Valutato    | GMS MED                                |                         | 3    | 84,53            | 55,30             | 29,23               | 164.900,00     |
| 16           | Valutato    | General Medical<br>Merate S.p.A.       |                         | 4    | 79,46            | 54,35             | 25,11               | 192.000,00     |
| 16           | Valutato    | METALTRONICA                           |                         | 5    | 76,18            | 46,18             | 30,00               | 160.675,00     |

Bonatti Rol

*[Signature]*

Ala. 1

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
*Ufficio acquisizione attrezzature - beni - comodati*

**Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014.**

## VERBALE N. 2

Il giorno 3.2.2021 alle ore 12,00 il Presidente della Commissione, nominata con deliberazione n. 1472 del 16.10.2020, Dott. Alberto Rocco, in seduta riservata procede alla verbalizzazione dei punteggi tecnici riportati da ciascuna ditta partecipante alla gara a Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, indetta con deliberazione n. 1574 del 21.11.2020.

La Commissione riunita è così composta:

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE | Dott. Alberto Rocco – Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria                         |
| COMPONENTE | Dott. Ottavio Bonati – Dirigente Medico U.O.S.D. Oculistica                                |
| COMPONENTE | Dott. Michele Galluzzo – Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini in urgenza ed emergenza |

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Laura Giusti – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente prende atto che la commissione si è riunita in seduta riservata, per la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 4 punti 4.1 e 4.1.1 del Capitolato di gara, come di seguito riportato.

Il giorno 24 novembre 2020 – ore 9,30:

la Commissione presente al completo, ha esaminato le offerte presentate per i seguenti Lotti:

### **Lotto n. 1: Audiometro clinico**

Ditte partecipanti: Inventis S.r.l. – Natus Medical S.r.l. – M.R.S. S.r.l.

**Ditta Inventis S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Natus Medical S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta M.R.S. S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata non è esaustiva sia per la valutazione sul possesso dei requisiti minimi dell'apparecchiatura offerta sia per la valutazione delle caratteristiche migliorative per l'attribuzione del punteggio di qualità. La Ditta viene pertanto esclusa.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 1**.

32

 *Bonati*

**Lotto n. 2: Impedenziometro clinico**

Ditte partecipanti: Inventis S.r.l. – Natus Medical S.r.l. – M.R.S. S.r.l.

**Ditta Inventis S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Natus Medical S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta M.R.S. S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata non è esaustiva sia per la valutazione sul possesso dei requisiti minimi dell'apparecchiatura offerta sia per la valutazione delle caratteristiche migliorative per l'attribuzione del punteggio di qualità. La Ditta viene pertanto esclusa.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 2**.

**Lotto n. 3: Videonistagmografo**

Ditte partecipanti: Inventis S.r.l.

**Ditta Inventis S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 3**.

**Lotto n. 4: Potenziali evocati uditivi**

Ditte partecipanti: Inventis S.r.l. – Natus Medical S.r.l.

**Ditta Inventis S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Natus Medical S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 4**.

Il giorno 1° dicembre 2020 – ore 9,30:

la Commissione presente al completo, ha esaminato le offerte presentate per i seguenti Lotti:

**Lotto n. 5: Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione**

Ditte partecipanti: Inventis S.r.l. – Natus Medical S.r.l.

**Ditta Inventis S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Natus Medical S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 5**.

Il punteggio riportato dalla **Ditta Inventis S.r.l.** è inferiore a 42 punti come richiesto nell'art. 18 punto 4 del Disciplinare di gara. La Ditta pertanto viene esclusa.



**Lotto n. 6: Trapano chirurgico**

Ditte partecipanti: Medtronic Italia S.p.A. – Olympus Italia S.p.A. – Stryker Italia S.r.l. – Dueffe 2000 S.r.l. – VE.DI.SE Hospital S.p.A.

**Ditta Medtronic Italia S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Olympus Italia S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Stryker Italia S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Dueffe 2000 S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta VE.DI.SE. Hospital S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 6.**

**Lotto n. 7: Laser chirurgico**

Ditte partecipanti: Deka M.E.L.A. S.r.l.

**Ditta Deka M.E.L.A. S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 7.**

Il punteggio riportato dalla **Ditta Deka M.E.L.A. S.r.l.** è inferiore a 42 punti come richiesto nell'art. 18 punto 4 del Disciplinare di gara. La Ditta pertanto viene esclusa.

**Lotto n. 8: Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL**

Ditte partecipanti: Olympus Italia S.p.A. – Dueffe 2000 S.r.l.

**Ditta Olympus Italia S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Dueffe 2000 S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 8.**

Il giorno 14 dicembre – ore 9,30:

la Commissione presente al completo, ha esaminato le offerte presentate per i seguenti Lotti:

**Lotto n. 9: Sistema riunito da visita ORL**

Ditte partecipanti: VE.DI.SE Hospital S.p.A.

**Ditta VE.DI.SE Hospital S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 9.**



Il punteggio riportato dalla **Ditta VE.DI.SE Hospital S.p.A.** è inferiore a 42 punti come richiesto nell'art. 18 punto 4 del Disciplinare di gara. La Ditta pertanto viene esclusa.

34

Baret

**Lotto n. 10: Oftalmoscopio binoculare indiretto**

Ditte partecipanti: Tec Med S.r.l. – Medika Vision S.r.l. – Optariston Oftalmologia S.r.l. – Biophysica S.r.l.

**Ditta Tec Med S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Medika Vision S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Biophysica S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 10**

**Lotto n. 11: Campimetro**

Ditte partecipanti: Carl Zeiss S.p.A. – Tec Med S.r.l. – Optariston Oftalmologia S.r.l. – Biophysica S.r.l.

**Ditta Carl Zeiss S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Tec Med S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Biophysica S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 11.**

g

**Lotto n. 12: Ottotipo a proiezione**

Ditte partecipanti: Tec Med S.r.l. – Medika Vision S.r.l. – Optariston Oftalmologia S.r.l. – Biophysica S.r.l.

**Ditta Tec Med S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Medika Vision S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

**Ditta Biophysica S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 12.**

Il giorno 15 dicembre – ore 9,30:

la Commissione presente al completo, ha esaminato le offerte presentate per i seguenti Lotti:

**Lotto n. 13: Frontofocometro**

Ditte partecipanti: Carl Zeiss S.p.A. – Tec Med S.r.l. – Medika Vision S.r.l. – Optariston Oftalmologia S.r.l. – Biophysica S.r.l.

**Ditta Carl Zeiss S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: [benieservizi@scamilloforlanini.rm.it](mailto:benieservizi@scamilloforlanini.rm.it) - tel: 06 55552580 – 2588 – 2589 – fax: 06 55552603

mita

R 35  
Secret

**Ditta Tec Med S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Medika Vision S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Biophysica S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 13.**

Il punteggio riportato dalla **Ditta Medika Vision S.r.l.** è inferiore a 42 punti come richiesto nell'art. 18 punto 4 del Disciplinare di gara. La Ditta pertanto viene esclusa.

#### **Lotto n. 14: Autorefrattometro con cheratometria**

Ditte partecipanti: Tec Med S.r.l. – Medika Vision S.r.l. – Optariston Oftalmologia S.r.l. – Biophysica S.r.l.

**Ditta Tec Med S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Medika Vision S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Biophysica S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 14.**

#### **Lotto n. 15: Microscopio operatorio**

Ditte partecipanti: Carl Zeiss S.p.A. – Leica Microsystems S.r.l. – Tec Med S.r.l. – Optariston Oftalmologia S.r.l.

**Ditta Carl Zeiss S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Leica Microsystems S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Tec Med S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

g

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 15, tranne che per la prova pratica che ha avuto luogo nei giorni 2 e 3 febbraio 2021.**

#### **Lotto n. 16: Sistema radiologico diretto multifunzione**

Ditte partecipanti: General Medica Merate S.p.A. – GE Medical Systems Italia S.p.A. – Metaltronica S.p.A. – GMS Med S.r.l. – Trade-Art 2000 S.p.A.

**Ditta General Medica Merate S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Metaltronica S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta GMS Med S.r.l.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.  
**Ditta Trade Art 2000 S.p.A.:** la documentazione tecnica presentata è regolare e conforme.

La commissione attribuisce i punteggi come da **allegato n. 16**

mta

Il giorno 2 febbraio 2021 alle ore 10,00:

La Commissione tecnica ha effettuato la prova pratica delle apparecchiature presentate dalle Ditte Carl Zeiss S.p.A. e Leica Microsystems S.r.l. attribuendo i seguenti punteggi:

Ditta Carl Zeiss S.p.A. : giudizio ottimo - Punti 7  
Ditta Leica Microsystems S.r.l. : giudizio ottimo - Punti 7

Il giorno 3 febbraio 2021 alle ore 10,00:

La Commissione tecnica ha preso atto che la Ditta Tec Med. S.r.l. e la Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l., convocate rispettivamente alle ore 10,00 e alle 11,00, non si sono presentate e si è aggiornata alle ore 12,00 per completare la valutazione del lotto n. 15.

La Commissione di nuovo riunita provvede pertanto ad aggiornare l'allegato n. 15 con i punteggi relativi alla prova pratica.

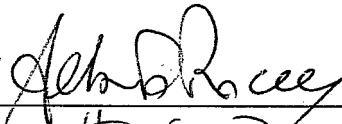

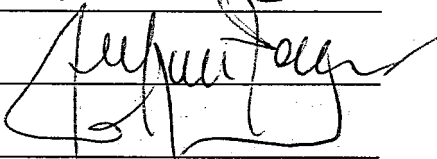

I punteggi riportati dalla **Ditta Tec Med S.r.l.** e dalla **Ditta Optariston Oftalmologia S.r.l.** sono inferiori a 42 punti come richiesto nell'art. 18 punto 4 del Disciplinare di gara. Le Ditte pertanto vengono escluse.

La Commissione redige un prospetto riepilogativo dei punteggi tecnici riportati per ciascun lotto (allegato 17).

Il Presidente conclude i lavori e la commissione si aggiorna al 24-2-2021 l'apertura delle offerte economiche direttamente sul portale STELLA.

Letto, confermato e sottoscritto

|            |                        |
|------------|------------------------|
| PRESIDENTE | Dott. Alberto Rocco    |
| COMPONENTE | Dott. Ottavio Bonati   |
| COMPONENTE | Dott. Michele Galluzzo |
| SEGRETARIO | Sig.ra Laura Giusti    |

Lotto I Audiometro clinico (60 punti su 70) – q.tà 3

94.4

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                                                                                                                                                                                         | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                                                                                                                                       | INVENTIS  |       | NATUS MEDICAL S.r.l. |       | M.R.S. S.r.l. |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | compilare | punti | compilare            | punti | compilare     |                                                                                            |
| *Preferibilmente possibilità di impostare la risoluzione frequenziale all'interno di un ampio range di valori                                                                                                                                                                        | max punti 6 (sarà preferito range maggiormente ampio e con maggior numero di intervalli per ogni tipologia di test)                                                                                                                                                              |           | 6     |                      | 6     | X             | ESCLUSA PER DOCUMENTAZIONE TECNICA INCOMPLETA (OFFERTA MUTA, CONTRATTO DI ASSISTENZA, ECC) |
| *Possibilità di effettuare almeno:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ Audiometria tonale sia via aerea che via ossea;</li> <li>○ Audiometria vocale sia in cuffia che via aerea;</li> <li>○ Mascheramento NBN;</li> <li>○ Mascheramento WN;</li> <li>○ TEN TEST;</li> </ul> | max punti 10 (sarà preferita elevata gamma di test con particolare interesse verso:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ MBL;</li> <li>○ ABLB;</li> <li>○ DLJ;</li> <li>○ SISI;</li> <li>○ STENGER;</li> <li>○ Mascheramento SN;</li> <li>○ Mascheramento MLD)</li> </ul> |           | 10    |                      | 10    | X             |                                                                                            |
| *Possibilità di effettuare almeno le seguenti stimolazioni:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tono puro;</li> <li>○ Tono pulsato;</li> <li>○ Tono Warble;</li> <li>○ Tono Warble pulsato;</li> <li>○ Rumore</li> </ul>                                                     | max punti 6 (sarà preferito numero superiore di stimolazioni)                                                                                                                                                                                                                    |           | 6     |                      | 6     | X             |                                                                                            |

R Beccet 37

8

EP/97

06.1

Beet 38

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                           |     |                                                   |      |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|---|--|
| Provisto di pannello di controllo dell'audiometro per impostazione, controllo e regolazione dei test | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche, con particolare attenzione a:<br>o Interfaccia semplice ed intuitiva;<br>o Dimensioni maggiori possibile)                        | Ottimo<br>dotato di touch screen ampio e con interfaccia intuitiva        | 7   | Sufficiente<br>privo di interfaccia user friendly | 1,75 | X |  |
| Possibilità di effettuare audiometria automatica e Bekeyes test                                      | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                       | SI                                                                        | 2   | SI                                                | 2    | X |  |
| *Dotato di memoria flash                                                                             | max punti 4 (sarà preferita capienza superiore)                                                                                                                                    |                                                                           | 4   | Non rilevabile                                    | 0    | X |  |
| Dotato di pc di ultima generazione                                                                   | max punti 6 (saranno valutate le caratteristiche con particolare riferimento a:<br>o CPU;<br>o Sistema operativo;<br>o Capacità ram;<br>o Monitor;<br>o Mouse e tastiera wireless) | Buono<br>dotato di PC performante anche se non top di gamma               | 4,5 | Ottimo<br>dotato di PC di ultima generazione      | 6    | X |  |
| Implementabile con audiometria infantile                                                             | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                       | SI                                                                        | 2   | SI                                                | 2    | X |  |
| *Accessori a corredo                                                                                 | max punti 5 (saranno valutate quantità e tipologie atte a migliorare l'offerta)                                                                                                    | 5<br>stampante laser a colori, pc minitower con tastiera e mouse wireless | 5   | 3<br>stampante in B/N, pc notebook                | 3    | X |  |
| Altoparlanti per campo libero                                                                        | max punti 4 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>o Efficienza;<br>o Risposta in frequenza)<br>o                                                   | Ottimo<br>dotato di casse di qualità                                      | 4   | Ottimo<br>dotato di casse di qualità              | 4    | X |  |

up

g

AG

| *Dimensioni                                                             | max punti 2 (saranno preferiti ingombri ridotti)           | 470 x 400 x 350 mm                                                                                                                                                                                                 | 0    | 325 x 255 x 60 mm                                                                                                                               | 2    | X |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| *Peso                                                                   | max punti 2 (sarà preferito peso ridotto)                  | 4.4 Kg                                                                                                                                                                                                             | 0    | 1,3 kg                                                                                                                                          | 2    | X |
| Ergonomia                                                               | max punti 4 (sarà preferita maggiore facilità di utilizzo) | Ottimo<br>Le dimensioni complessive, il touch screen ampio e l'interfaccia informatica intuitiva conferiscono una ottima ergonomia al prodotto anche per il personale che non utilizza routinariamente il prodotto | 4    | Sufficiente<br>La mancanza di una interfaccia user friendly consentono un utilizzo sicuro al personale che utilizza routinariamente il prodotto | 1    | X |
| Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                 |      |   |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti                                                | Non sufficiente<br>Non c'è estensione oltre il periodo minimo richiesto                                                                                                                                            | 0    | Non sufficiente<br>Non c'è estensione oltre il periodo minimo richiesto                                                                         | 0    | X |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti                                                | Buono                                                                                                                                                                                                              | 1,5  | Ottimo                                                                                                                                          | 2    | X |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata             | max 2,5 punti                                              | Discreto                                                                                                                                                                                                           | 1,25 | Discreto                                                                                                                                        | 1,25 | X |
| Fornitura muletti sostitutivi                                           | max 2,5 punti                                              | Non sufficiente                                                                                                                                                                                                    | 0    | Ottimo                                                                                                                                          | 2,5  | X |

Totale

57,25

Totale

51,50

Totale

//

TEP  
as

89

Boerel  
3P

**Lotto 2 Impedenziometro clinico (60 punti su 70) – q.tà 2**

20.21

*Secret*  
50

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                                                                                                                                                              |  | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                               |  | INVENTIS |                                                                   | NATUS MEDICAL S.r.l. |            | M.R.S. S.r.l. |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | completare                                                                                                                                                               |  | punti    | completare                                                        | punti                | completare | punti         | completare                              |
| *Idoneo ad eseguire almeno:                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                          |  |          |                                                                   |                      |            |               |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timpanometria;</li> <li>• Test dei riflessi acustici con stimolo ipsilaterale e contro laterale;</li> <li>• Decadenza del riflesso;</li> <li>• Latenza del riflesso;</li> <li>• Funzione tubarica ETF</li> </ul> |  | max punti 4 (sarà preferita gamma esami più ampia possibile)                                                                                                             |  | 4        |                                                                   | 4                    | X          |               | DOCUMENTAZIONE<br>TECNICA<br>INCOMPLETA |
| *Display LCD TFT touch screen da almeno 7"                                                                                                                                                                                                                |  | max punti 4 (saranno preferite dimensioni superiori)                                                                                                                     |  | 4        |                                                                   | 4                    | X          |               |                                         |
| Display a colori                                                                                                                                                                                                                                          |  | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                             |  | 2        | SI                                                                | 2                    | X          |               |                                         |
| *Dotato almeno di uscite per:                                                                                                                                                                                                                             |  | max punti 3 (sarà preferito maggior numero di uscite)                                                                                                                    |  | 3        |                                                                   | 3                    | X          |               |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonda esami;</li> <li>• Cuffie/auricolari</li> </ul>                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                          |  |          |                                                                   |                      |            |               |                                         |
| Completo di pc di ultima generazione                                                                                                                                                                                                                      |  | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche con particolare riferimento a:                                                                                          |  | 3,5      | Discreto<br>PC di ultima generazione<br>anche se non top di gamma | 5,25                 | X          |               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o CPU</li> <li>o Sistema operativo;</li> <li>o Capacità ram;</li> <li>o Monitor;</li> <li>o Mouse e tastiera wireless)</li> </ul> |  |          |                                                                   |                      |            |               |                                         |
| Provvisto di stampante laser di ultima generazione                                                                                                                                                                                                        |  | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                             |  | 2        | SI                                                                | 0                    | X          |               |                                         |
| Preferibilmente possibilità di seguire l'esame da PC                                                                                                                                                                                                      |  | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                             |  | 2        | SI                                                                | 2                    | X          |               |                                         |
| *Tono sonda                                                                                                                                                                                                                                               |  | max punti 4 (sarà preferito numero superiore di toni con particolare attenzione verso:                                                                                   |  | 4        |                                                                   | 4                    | X          |               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o 226 Hz;</li> <li>o 1 KHz)</li> </ul>                                                                                            |  |          |                                                                   |                      |            |               |                                         |

*20.21*

*2*

Alu-21

Secret 51

|                                |                                                            |                                                                                                               |   |                                                                                                               |     |   |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| *Sonde in dotazione            | max punti 4 (sarà preferito quantitativo superiore)        |                                                                                                               | 4 |                                                                                                               | 4   | X |  |
| *Gamma di pressione            | max punti 4 (sarà preferito range maggiormente elevato)    |                                                                                                               | 4 |                                                                                                               | 4   | X |  |
| *Velocità pompa                | max punti 4 (sarà preferito range maggiormente elevato)    | Maggiori velocità di variazione disponibili:                                                                  | 4 | Minori velocità di variazione disponibili:                                                                    | 2   | X |  |
| Idoneo all'impiego su bambini  | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                               | SI                                                                                                            | 2 | SI                                                                                                            | 2   | X |  |
| Interfaccia                    | max punti 5 (saranno predilette semplicità ed intuitività) | Ottimo<br>User friendly e di facile utilizzo anche per personale che non utilizza routinariamente il prodotto | 5 | Discreto<br>Interfaccia non massimamente intuitiva per personale che non utilizza routinariamente il prodotto | 2,5 | X |  |
| *Dimensione                    | max punti 2,5 (saranno preferiti ingombri ridotti)         | 320 x 390 x 150 mm<br>Dimensioni accettabili ma comunque eccessive rispetto all'adeguatezza degli spazi       | 1 | 190 x 248 x 261 mm<br>Dimensioni accettabili ma comunque eccessive rispetto all'adeguatezza degli spazi       | 1,5 | X |  |
| *Peso                          | max punti 2,5 (sarà preferito peso ridotto)                | 2.0 kg<br>Peso accettabile ma comunque eccessivo rispetto a quanto ritenuto adeguato                          | 2 | 2.65 kg<br>Peso accettabile ma comunque eccessivo rispetto a quanto ritenuto adeguato                         | 1   | X |  |
| Ergonomia                      | max punti 5 (maggior facilità di utilizzo)                 | Ottimo                                                                                                        | 5 | Discreto<br>Non user friendly                                                                                 | 2,5 | X |  |
| *Ulteriori accessori a corredo | max punti 3 (saranno preferite quantità superiori)         |                                                                                                               | 2 |                                                                                                               | 2   | X |  |

Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)

|                                                                         |               |                 |      |                 |     |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------|-----|---|--|
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti   | Non sufficiente | 0    | Non sufficiente | 0   | X |  |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti   | Discreto        | 1    | Ottimo          | 2   | X |  |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata             | max 2,5 punti | Buono           | 1,87 | Ottimo          | 2,5 | X |  |

*[Signature]*

*[Signature]*

Al. 21

| Fornitura muletti sostitutivi | max 2,5 punti | Non sufficiente | 0 | Ottimo | 2,5 | X |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---|--------|-----|---|
|-------------------------------|---------------|-----------------|---|--------|-----|---|

**Totale**      **56,37**      **Totale**      **52,75**      **Totale**      //

*u/a*

*g*

*Report 42*

**Lotto 3 Videonistagmografo (60 punti su 70) – q.tà 1**

AU. 3

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                             |  | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                           | INVENTIS  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| SISTEMA                                                                                                  |  |                                                                                      | compilare | punti |
| Dotato di N° 4 canali di acquisizione                                                                    |  |                                                                                      |           |       |
| *Idoneo a consentire il salvataggio degli esami su PC                                                    |  | max punti 2 (SI = 2, NO = 0)                                                         | NO        | 0     |
| *Preferibilmente possibilità di controllo remoto                                                         |  | max punti 3 (sarà preferito il salvataggio del maggior numero di video)              |           | 3     |
| *Possibilità di registrazione video e salvataggio su PC                                                  |  | max punti 3 (sarà preferito controllo mediante telecomando)                          |           | 3     |
| Preferibilmente interfacciabile e sincronizzabile ad otocalorimetro mediante apposito cavo               |  | max punti 4 (sarà prediletta la possibilità di salvare video di maggiore durata)     |           | 4     |
| Preferibilmente dotato di 2 video-output per la visione su monitor esterni degli occhi destro e sinistro |  | max punti 2 (SI = 2, NO = 0)                                                         | SI        | 2     |
| Ergonomia                                                                                                |  | max punti 2 (SI = 2, NO = 0)                                                         | NO        | 0     |
|                                                                                                          |  | max punti 4 (sarà prediletta maggiore facilità di utilizzo)                          | Ottimo    | 4     |
| STIMOLAZIONE OTTICA                                                                                      |  |                                                                                      |           |       |
| Video Proiettore o Video Monitor                                                                         |  | max punti 2 (SI = 2, NO = 0)                                                         | SI        | 2     |
| *Idoneo almeno all'esecuzione delle seguenti tipologie di test:                                          |  | max punti 6 (sarà preferito maggior numero di test con particolare attenzione verso: |           | 4     |
| o Test Gaze;                                                                                             |  | o Nistagmo;                                                                          |           |       |
| o Test Pursuit;                                                                                          |  | o Inseguimento lento;                                                                |           |       |
| o Test Saccadici;                                                                                        |  | o Test di fissazione)                                                                |           |       |
| o Test Ottocinetici                                                                                      |  |                                                                                      |           |       |
| Preferibilmente stimolazione ottica generata mediante software                                           |  | max punti 1 (SI = 1, NO = 0)                                                         | SI        | 1     |
| Preferibilmente possibilità di personalizzare la stimolazione                                            |  | max punti 2 (SI = 2, NO = 0)                                                         | SI        | 2     |
| Luce di fissazione durante i test                                                                        |  | max punti 1 (SI = 1, NO = 0)                                                         | SI        | 1     |
| MASCHERA BINOCULARE                                                                                      |  |                                                                                      |           |       |
| *Frequenza di campionamento almeno pari a circa 50 Hz                                                    |  | max punti 4 (sarà preferito valore superiore)                                        |           | 4     |

*Deed*  
43

*mta*

*9*

AG. 3

Secret 44

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| * Peso inferiore a 600 g                                                                             | max punti 5 (sarà preferita maggiore leggerezza)                                                                                                                                                                                                                                      | Ottimo          | 5   |
| * Ampiezza dell'inseguimento oculare pari a circa $\pm 30^\circ$ sia in verticale che in orizzontale | max punti 2 (sarà preferita ampiezza maggiore)                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 2   |
| * Alimentazione a basso voltaggio                                                                    | max punti 2 (sarà preferito valore inferiore)                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 1   |
| Ergonomia                                                                                            | max punti 4 (sarà preferita maggiore facilità di utilizzo e maggior comfort nell'indossare la maschera)                                                                                                                                                                               | Ottimo          | 4   |
| * Accessori a corredo dell'intero sistema                                                            | max punti 3 (saranno preferite quantità superiori)                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 1   |
| PC di ultima generazione con unità CD-R/W per backup e hard disk ad elevata capacità                 | max punti 6 (saranno valutate le caratteristiche con particolare riferimento a:<br><input type="radio"/> CPU<br><input type="radio"/> Sistema operativo;<br><input type="radio"/> Capacità ram;<br><input type="radio"/> Monitor;<br><input type="radio"/> Mouse e tastiera wireless) | Discreto        | 3   |
| Stampante laser a colori di ultima generazione                                                       | max punti 2 (SI = 2, NO = 0)                                                                                                                                                                                                                                                          | SI              | 2   |
| <b>Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |     |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato                              | max 3 punti                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non sufficiente | 0   |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                                                   | max 2 punti                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ottimo          | 2   |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata                                          | max 2,5 punti                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ottimo          | 2,5 |
| Fornitura muletti sostitutivi                                                                        | max 2,5 punti                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non sufficiente | 0   |

Totale 52,50

*[Signature]*

*[Signature]*

**Lotto 4 Potenziali evocati uditivi (60 punti su 70) – q.tà**

Au-4

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                                                                                                                                                                          | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                                                                                                                 | INVENTIS                                             |       | NATUS MEDICAL S.r.l.     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | compilare                                            | punti | compilare                | punti |
| *Dotato almeno delle seguenti stimolazioni:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tone click;</li> <li>○ Tone burst</li> </ul>                                                                                                                                  | max punti 8 (sarà preferito numero di stimolazioni maggiormente elevato)                                                                                                                                                                                   |                                                      | 8     |                          | 8     |
| *Possibilità di impostare la frequenza di stimolazione all'interno di un ampio range                                                                                                                                                                                  | max punti 8 (sarà preferito range più ampio con maggior numero di intervalli per ogni tipologia di stimolazione)                                                                                                                                           | maggior range di frequenza anche con stimoli diversi | 8     | minor range di frequenza | 4     |
| *Adeguate per l'esecuzione almeno delle seguenti tipologie di test:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ ECoG;</li> <li>○ ABR;</li> <li>○ MLR;</li> <li>○ VEMP;</li> <li>○ VEMP bone;</li> <li>○ Ocular VEMP;</li> <li>○ Test corticali P300 e ASSR</li> </ul> | max punti 8 (sarà preferito numero maggiormente elevato con particolare riferimento a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ LLR,</li> <li>○ ALR</li> </ul>                                                                                          | maggior numero di test                               | 8     | Minor numero di test     | 0     |
| Preferibilmente provvisto di canale aggiuntivo utilizzabile per VEMP                                                                                                                                                                                                  | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                   | 3     | SI                       | 3     |
| *Completo di PC desktop di ultima generazione                                                                                                                                                                                                                         | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ CPU</li> <li>○ Sistema operativo;</li> <li>○ Capacità ram;</li> <li>○ Monitor;</li> <li>○ Mouse e tastiera wireless)</li> </ul> | intel duo windows 7                                  | 5     | intel core i7 windows 10 | 6     |
| *Dimensioni                                                                                                                                                                                                                                                           | max punti 2,5 (saranno prediletti ingombri ridotti)                                                                                                                                                                                                        | 190 mm x 140 mm x 50 mm                              | 2,5   | (mm) 300X250X40          | 1     |

Boerel

45

Luca

g

|                                                                         |                                                                                                                                  |                                             |              |                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| *Peso                                                                   | max punti 2,5 (sarà prediletto peso ridotto)                                                                                     | Inferiore a 1 Kg                            | 2,5          | (kg) 1.5                                                | 0            |
| Sistema portatile                                                       | max punti 4 (SI = 4; NO = 0)                                                                                                     | SI                                          | 4            | SI                                                      | 4            |
| *Accessori a corredo                                                    | max punti 4 (saranno valutate caratteristiche e quantità)                                                                        | maggior numero di elementi                  | 4            | minor numero di elementi                                | 0            |
| Carrello per alloggiamento e trasporto                                  | max punti 5 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>o Braccio porta monitor<br>o Alloggiamento PC) | Ottimo<br>Alloggiamento PC e monitor comodi | 5            | Discreto<br>Ergonomia del sistema lievemente dispersiva | 2,5          |
| Ergonomia                                                               | max punti 8 (sarà preferita maggiore semplicità e facilità di utilizzo)                                                          | Ottimo                                      | 8            | ottimo                                                  | 8            |
| <b>Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)</b>             |                                                                                                                                  |                                             |              |                                                         |              |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti                                                                                                                      | Non sufficiente                             | 0            | Non sufficiente                                         | 0            |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti                                                                                                                      | Discreto                                    | 1            | Ottimo                                                  | 2            |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata             | max 2,5 punti                                                                                                                    | Buono                                       | 1,87         | Ottimo                                                  | 2,5          |
| Fornitura muletti sostitutivi                                           | max 2,5 punti                                                                                                                    | Non sufficiente                             | 0            | Ottimo                                                  | 2,5          |
| <b>Totale</b>                                                           |                                                                                                                                  |                                             | <b>60,87</b> | <b>Totale</b>                                           | <b>43,50</b> |

*Beet*  
46

*gr*

*me*

**Lotto 5 Otoemissioni acustiche con prodotto di distorsione (60 punti su 70) - q.tà 1**

76.5

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                            | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                    | INVENTIS                                    |       | NATUS MEDICAL S.r.l. |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------|-------|
|                                                                         |                                                                                                               | compilare                                   | punti | compilare            | punti |
| Idoneo all'esecuzione di screening timpanometrico                       | max punti 7 (SI = 7, NO = 0)                                                                                  | NO                                          | 0     | NO                   | 0     |
| Elevata personalizzazione dello stimolo                                 | max punti 9 (sarà preferita maggiore versatilità)                                                             | Buono                                       | 6,75  | Buono                | 6,75  |
| *Range frequenziali                                                     | max punti 9 (sarà preferito range più ampio e con il maggior numero di intervalli per ogni tipologia di test) |                                             | 7     |                      | 7     |
| *Dimensioni                                                             | max punti 4 (sarà preferito sistema meno ingombrante)                                                         |                                             | 4     |                      | 4     |
| *Peso                                                                   | max punti 4 (sarà preferito sistema più leggero)                                                              |                                             | 4     |                      | 4     |
| Interfaccia                                                             | max punti 8 (sarà preferita interfaccia semplice ed intuitiva)                                                | Discreto<br>Non adeguatamente user friendly | 4     | Ottimo               | 8     |
| Integrabile nel sistema dei potenziali evocati                          | max punti 6 (SI = 6, NO = 0)                                                                                  | NO                                          | 0     | SI                   | 6     |
| *Accessori a corredo                                                    | max punti 7 (saranno valutate quantità e tipologie)                                                           |                                             | 5     |                      | 5     |
| <b>Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)</b>             |                                                                                                               |                                             |       |                      |       |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti                                                                                                   | Non sufficiente                             | 0     | Non sufficiente      | 0     |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti                                                                                                   | Discreto                                    | 1     | Ottimo               | 2     |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata             | max 2,5 punti                                                                                                 | Discreto                                    | 1,25  | Ottimo               | 2,5   |
| Fornitura muletti sostitutivi                                           | max 2,5 punti                                                                                                 | Non sufficiente                             | 0     | Ottimo               | 2,5   |

**Totale**

**33,00**

**Totale**

**47,75**

9

R. Baret  
57

**Lotto 6 Trapano chirurgico (60 punti su 70) – q.tà 1**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                   | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                           | MEDTRONIC ITALIA S.p.A. |       | OLYMPUS ITALIA S.r.l. |       | STRYKER ITALIA |       | DUEFFE 2000 S.r.l. |       | VE.DI.SE. HOSPITAL |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | Compilare               | punti | Compilare             | punti | Compilare      | punti | Compilare          | punti | Compilare          | punti |
| *Sistema di irrigazione regolabile almeno all'interno del range da 5 a 100 ml                                  | max punti 5 (sarà preferito range più ampio e con maggior numero di intervalli)                                                                                      |                         | 5     |                       |       |                | 4     |                    | 3     |                    | 3     |
| *Munito di monitor touch screen per rapida impostazione dell'attività chirurgica                               | max punti 5 (saranno preferite dimensioni superiori)                                                                                                                 |                         | 5     |                       |       |                | 3     |                    | 5     |                    | 3     |
| *Dotato di:                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                         |       |                       |       |                |       |                    |       |                    |       |
| • Manipolo otologico ad alta velocità per dissezione ossea completo di attacco retto e angolato;               | max punti 6 (sarà preferito numero superiore di manipoli con particolare attenzione a:<br>o Microtrapano otologico per chirurgia stapedioplastica)                   |                         | 6     |                       |       |                | 6     |                    | 6     |                    | 6     |
| • Manipolo ergonomico per chirurgia endonasale idoneo all'utilizzo di frese per chirurgia dei seni paranasali; |                                                                                                                                                                      |                         |       |                       |       |                |       |                    |       |                    |       |
| Manipolo otologico ad alta velocità per dissezione ossea completo di attacco retto e angolato                  | max punti 6 (saranno analizzate le caratteristiche con particolare attenzione alla velocità)                                                                         | Ottimo                  | 6     | Ottimo                | 6     | Ottimo         | 6     | Ottimo             | 6     | Ottimo             | 6     |
| Manipolo ergonomico per chirurgia endonasale idoneo all'utilizzo di frese per chirurgia dei seni paranasali    | max punti 6 (saranno analizzate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>o Velocità;<br>o Angolo di rotazione della finestra di taglio;<br>o Aspirazione) | Ottimo                  | 6     | Ottimo                | 6     | Ottimo         | 6     | Ottimo             | 6     | Ottimo             | 6     |
| Preferibilmente fornito di sistema di irrigazione integrato                                                    | max punti 4 (SI = 4; NO = 0)                                                                                                                                         | SI                      | 4     | SI                    | 4     | SI             | 4     | SI                 | 4     | SI                 | 4     |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
48

Al. 6

AU.6

Secret  
4P

|                                                                          |                                                                         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----|
| *Sistema di irrigazione integrato regolabile mediante pompa peristaltica | max punti 4 (sarà preferito elevato range di regolazione)               | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4   |
| Pedale multifunzionale che consenta almeno:                              | max punti 4 (sarà preferita regolazione di elevato numero di parametri) | 4               | Ottimo | 4               | Ottimo | 4               | Ottimo | 4               | Ottimo | 4               | Ottimo | 4               | Ottimo | 4   |
| • Regolazione della velocità;                                            |                                                                         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |     |
| • Cambio del verso di rotazione;                                         |                                                                         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |     |
| • Cambio del manipolo attivo                                             |                                                                         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |     |
| Riconoscimento automatico del manipolo                                   | max punti 4 (SI = 4; NO = 0)                                            | 4               | SI     | 4               | SI     | 4               | SI     | 4               | SI     | 4               | SI     | 4               | SI     | 4   |
| *Possibilità di regolazione della finestra di taglio                     | max punti 4 (sarà preferito ampio range di regolazione)                 | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4               |        | 4   |
| *Dimensioni                                                              | max punti 2 (sarà preferito sistema più piccolo)                        | 1,5             |        | 1,5             |        | 1               |        | 1,5             |        | 1,5             |        | 2               |        | 2   |
| *Peso                                                                    | max punti 2 (sarà preferito sistema più leggero)                        | 1,5             |        | 1               |        | 1,5             |        | 2               |        | 2               |        | 2               |        | 2   |
| Ergonomia                                                                | max punti 3 (sarà prediletta maggiore facilità di utilizzo)             | 3               | Ottimo | 3               | Ottimo | 3               | Ottimo | 3               | Ottimo | 3               | Ottimo | 3               | Ottimo | 3   |
| *Accessori a corredo                                                     | max punti 5 (saranno considerate quantità e tipologie)                  | 5               | Ottimo | 5               | Ottimo | 5               | Ottimo | 5               | Ottimo | 5               | Ottimo | 5               | Ottimo | 5   |
| Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)                     |                                                                         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |     |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato  | max 3 punti                                                             | Non sufficiente | 0      | Non sufficiente | 0      | Non sufficiente | 0      | Non sufficiente | 0      | Non sufficiente | 0      | Non sufficiente | 0      | 0   |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                       | max 2 punti                                                             | Ottimo          | 2      | Ottimo          | 2      | Ottimo          | 2      | Ottimo          | 2      | Ottimo          | 2      | Ottimo          | 2      | 2   |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata              | max 2,5 punti                                                           | Ottimo          | 2,5    | Discreto        | 1,25   | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | 2,5 |
| Fornitura muletti sostitutivi                                            | max 2,5 punti                                                           | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | Ottimo          | 2,5    | 2,5 |
| Totale                                                                   |                                                                         | 66,00           | Totale | 64,25           | Totale | 60,00           | Totale | 60,50           | Totale | 59,00           |        |                 |        |     |

*[Signature]*

*[Signature]*

**Lotto 7 Laser chirurgico (60 punti su 70) – q.tà**

AU.7

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                                                                        | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                                                    | DEKA M.E.L.A. S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | compiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | punti |
| Braccio articolato                                                                                                                                                  | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>o Lunghezza;</li> <li>o Snodi;</li> <li>o Area descritta)</li> </ul> | <b>SUFFICIENTE</b><br>Il braccio è molto alto e ingombrante e inoltre necessita di regolazione con contrappeso e un raggio operativo massimo di 80cm                                                                                                                                                                                        | 1,75  |
| Utilizzabile con fibra monouso e poliuso                                                                                                                            | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     |
| Possibilità di passare da braccio articolato a fibra flessibile, e viceversa, mediante comando                                                                      | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     |
| *Potenza non inferiore a 30 W                                                                                                                                       | max punti 4 (sarà preferito valore superiore)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     |
| *Possibilità di adoperare almeno le seguenti modalità:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>o Continua;</li> <li>o Pulsata;</li> <li>o Superpulsata</li> </ul> | max punti 5 (sarà preferita elevata gamma di modalità)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     |
| *Preferibilmente possibilità di memorizzare procedure personalizzate                                                                                                | max punti 6 (sarà prediletto elevato numero di procedure)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     |
| *Dotato di schermo touch screen per impostare i parametri e la procedura chirurgica                                                                                 | max punti 4 (sarà preferito schermo più ampio)                                                                                                                                                | Il touch screen non si trova in posizione idonea per un immediato setting rispetto alla posizione seduta dell'operatore, essendo il laser molto alto                                                                                                                                                                                        | 2     |
| Preferibilmente dotato di software per la scelta dei parametri ottimali per le varie procedure chirurgiche                                                          | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
| *Completo di micromanipolatore per otorino                                                                                                                          | max punti 6 (saranno considerate distanza focale, visibilità e dimensioni dello spot)                                                                                                         | micromanipolatore dotato di specchi olografici che determinano una messa a fuoco con profondità di campo molto ristretta e conseguente carbonizzazione dei piani diversi dal piano del fuoco, elemento estremamente importante nella chirurgia laser oncologica laringea. Micromanipolatore non sterilizzabile e con movimento molto lento. | 2     |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
50

|                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Preferibilmente fibra a CO2 collegabile ad un manipolo dedicato per la chirurgia dell'orecchio | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    |
| *Ingombro                                                                                      | max punti 5 (sarà preferito ingombro ridotto)               | trattasi di un laser estremamente ingombrante (altezza con braccio chiuso 1,60 con braccio alzato 237) e pesante (100kg)                                                                                                                                                                                       | 0    |
| Ergonomia                                                                                      | max punti 6 (sarà prediletta maggiore facilità di utilizzo) | <b>NON SUFFICIENTE</b><br>Le dimensioni, intese come ingombro base, l'altezza con braccio ripiegato, l'altezza con braccio alzato, l'altezza del monitor in relazione all'utente in posizione seduta, il peso ed il raggio operativo condizionano la facilità di utilizzo anche nella fase di setting iniziale | 0    |
| *Accessori a corredo                                                                           | max punti 7 (saranno valutati tipologie e quantitativi)     | presenza di laser a diodi che seppur non richiesto non rappresenta un plus nella chirurgia oncologica della laringe                                                                                                                                                                                            | 3    |
| <b>Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)</b>                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato                        | max 3 punti                                                 | NON SUFFICIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                                             | max 2 punti                                                 | DISCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata                                    | max 2,5 punti                                               | DISCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,25 |
| Fornitura muletti sostitutivi                                                                  | max 2,5 punti                                               | OTTIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5  |

**Totale 38,50**

74.7

Beet  
51

7

**Lotto 8 Sistema di videoscopia ambulatoriale per ORL (60 punti su 70) – q.tà 1**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                             |                                                                                                                          | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                 | OLYMPUS ITALIA S.r.l. |                                                                                                                    | DUEFFE 2000 S.r.l. |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                            | compilare             |                                                                                                                    | punti              | compilare |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                            | punti                 |                                                                                                                    |                    |           |
| VIDEOPROCESSORE                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                                                                                                                    |                    |           |
| Sistema di enfattizzazione della struttura vascolare dello strato sottomucoso per aiutare la diagnosi precoce dei tumori | max punti 1,5 (sarà preferita tecnologia validata da studi nazionali ed internazionali che ne dimostrino l'affidabilità) | OTTIMO<br>Enfatizzazione della struttura vascolare realizzata con sistema ottico e non mediata da software | 1,5                   | BUONO<br>Enfatizzazione della struttura vascolare realizzata tramite elaborazione software dell'immagine acquisita | 1,12               |           |
| *Zoom                                                                                                                    | max punti 1,5 (sarà preferito maggior potere "zoomante")                                                                 |                                                                                                            | 1,5                   |                                                                                                                    | 1,5                |           |
| Dotato di zoom ottico ed elettronico                                                                                     | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                         | SI                                                                                                         | 0,5                   | NO                                                                                                                 | 0                  |           |
| *Sistema per la regolazione della luminosità                                                                             | max punti 1,5 (sarà prediletto range di regolazione più ampio)                                                           |                                                                                                            | 1,5                   |                                                                                                                    | 1,5                |           |
| Regolazione automatica e manuale della luminosità                                                                        | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                         | SI                                                                                                         | 0,5                   | NO                                                                                                                 | 0                  |           |
| *Dotato almeno dei seguenti ingressi/uscite:<br>o HD-SDI;<br>o DVD;<br>o DVI;<br>o USB                                   | max punti 1 (sarà preferito numero maggiormente elevato)                                                                 |                                                                                                            | 1                     |                                                                                                                    | 1                  |           |
| *Sistema di registrazione                                                                                                | max punti 2 (saranno valutate:<br>o Capacità di memoria del sistema;<br>o Possibilità di registrazione audio)            |                                                                                                            | 2                     |                                                                                                                    | 2                  |           |
| Porta USB frontale                                                                                                       | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                         | SI                                                                                                         | 0,5                   | SI                                                                                                                 | 0,5                |           |
| *Presenza di tasti programmabili sul lato frontale                                                                       | max punti 1 (sarà preferito numero maggiormente elevato)                                                                 |                                                                                                            | 1                     |                                                                                                                    | 1                  |           |
| FONTE DI LUCE                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                            |                       |                                                                                                                    |                    |           |
| *Lampada con elevata vita media                                                                                          | max punti 2 (sarà preferito valore superiore)                                                                            |                                                                                                            | 2                     |                                                                                                                    | 2                  |           |
| Lampada Xenon                                                                                                            | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                                                                                             | NO                                                                                                         | 0                     | NO                                                                                                                 | 0                  |           |
| Preferibilmente dotata di indicatore della vita della lampada                                                            | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                         | NO                                                                                                         | 0                     | NO                                                                                                                 | 0                  |           |

*Devel  
52*

*2*

*mi  
kg*


  
 Renato
   
 A.T.

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |      |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|------|
| Lampada di emergenza ad attivazione automatica in caso di guasto della lampada principale   | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                            | NO                          | 0    | NO         | 0    |
| Dotato di sistema di raffreddamento della lampada                                           | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                            | SI                          | 0,5  | SI         | 0,5  |
| Pedale di comando per sistema stroboscopico                                                 | max punti 1,5 (SI = 1,5; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                            | SI                          | 1,5  | SI         | 1,5  |
| *Display LED per la visualizzazione della frequenza fondamentale e dell'intensità del suono | max punti 1 (saranno preferite dimensioni maggiori)                                                                                                                                                                                                         |                             | 1    |            | 0    |
| Interfaccia                                                                                 | max punti 2 (saranno prediletti intuitività e facilità di utilizzo)                                                                                                                                                                                         | BUONO<br>Meno user friendly | 1,5  | OTTIMO     | 2    |
| CAVO LUCE                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |      |            |      |
| *Lunghezza non inferiore a 3 m                                                              | max punti 1 (sarà preferita maggiore lunghezza)                                                                                                                                                                                                             |                             | 1    |            | 1    |
| VIDEOLARINGOSCOPIO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |      |            |      |
| Risoluzione FULL HD                                                                         | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                                | SI                          | 1    | SI         | 1    |
| *Campo visivo di almeno 80°                                                                 | max punti 2 (sarà prediletto campo maggiormente ampio)                                                                                                                                                                                                      |                             | 2    |            | 2    |
| *Lunghezza operativa pari almeno a 30 cm                                                    | max punti 2 (sarà preferita lunghezza maggiore)                                                                                                                                                                                                             |                             | 2    |            | 2    |
| *Diametro non superiore a circa 3.9 mm                                                      | max punti 2 (sarà prediletto diametro inferiore)                                                                                                                                                                                                            | 3,9mm                       | 0    | 3,7mm      | 2    |
| *Possibilità di piegare la punta con angolo preferibilmente superiore a 120°                | max punti 2 (sarà prediletto angolo superiore)                                                                                                                                                                                                              | 130°                        | 0    | 140°       | 2    |
| Sistema per impostazione di parametri e/o funzionalità                                      | max punti 1,5 (saranno valutate le caratteristiche del sistema con particolare attenzione a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>o Semplicità di utilizzo;</li> <li>o Rapidità;</li> <li>o Quantità e tipologie di impostazioni gestibili)</li> </ul> | BUONO<br>Meno user friendly | 1,12 | OTTIMO     | 1,5  |
| *Presenza di pulsanti personalizzabili                                                      | max punti 1,5 (sarà preferito numero maggiormente elevato)                                                                                                                                                                                                  | 4 pulsanti                  | 1,5  | 3 pulsanti | 0    |
| Metodo di disinfezione/sterilizzazione                                                      | max punti 1,5 (saranno predilette rapidità e semplicità)                                                                                                                                                                                                    | OTTIMO                      | 1,5  | BUONO      | 1,12 |


*Belati*  
*Av. 8*

| TESTINA DELLA TELECAMERA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|------|
| *Sistema di comando                                                                                                                                                    | max punti 3 (saranno valutate le caratteristiche del sistema con particolare attenzione a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Facilità di utilizzo;</li> <li>Rapidità;</li> <li>Numero di parametri controllabili)</li> </ul> |                           | 3    |                | 3    |
| *Pulsanti                                                                                                                                                              | max punti 1,5 (sarà preferito numero maggiormente elevato)                                                                                                                                                                           | 5 pulsanti                | 1,5  | 3 pulsanti     | 1    |
| Impugnatura                                                                                                                                                            | max punti 1,5 (sarà preferita ergonomia superiore)                                                                                                                                                                                   | OTTIMO                    | 1,5  | OTTIMO         | 1,5  |
| *Dimensioni                                                                                                                                                            | max punti 0,75 (saranno preferite dimensioni ridotte)                                                                                                                                                                                |                           | 0,75 |                | 0,75 |
| *Peso                                                                                                                                                                  | max punti 0,75 (sarà preferito peso ridotto)                                                                                                                                                                                         | 295 gr                    | 0    | 130gr          | 0,75 |
| MONITOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |                |      |
| *Monitor LCD FULL HD da circa 26"                                                                                                                                      | max punti 1,5 (saranno preferite dimensioni superiori)                                                                                                                                                                               | monitor da 26"            | 0    | monitor da 27" | 1,5  |
| *Compatibile con un'ampia gamma di segnali video in ingresso                                                                                                           | max punti 1,5 (sarà preferito numero superiore con particolare attenzione a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Segnali HD;</li> <li>Segnali standard)</li> </ul>                                                             |                           | 1,5  |                | 1,5  |
| Preferibilmente possibilità di impostare rapidamente le funzioni usate più di frequente                                                                                | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                                                                                                                                                                                                         | SI                        | 1    | SI             | 1    |
| *Compatibile con le seguenti modalità di visualizzazione:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Picture-in-Picture PIP;</li> <li>Picture-on-Picture PoP</li> </ul> | max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore con particolare interesse per le modalità:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Rotate;</li> <li>Mirror)</li> </ul>                                                          | PIP, PoP, Rotate e Mirror | 2    | PIP, PoP       | 0    |
| CARRELLO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |                |      |
| *Almeno N° 5 prese IEC-IEC                                                                                                                                             | max punti 1,5 (sarà prediletto numero superiore)                                                                                                                                                                                     |                           | 1,5  |                | 1,5  |
| *Dotato di N° 4 ruote antistatiche piroettanti di cui almeno N° 2 con sistema di blocco                                                                                | max punti 1,5 (sarà preferito dispositivo frenante su ogni ruota)                                                                                                                                                                    |                           | 1,5  |                | 1,5  |

*[Signature]*

*R*  
*Beebe*  
*Aug*

55

|                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|
| *Fornito di almeno N° 3 ripiani                                                                                                                                                   | max punti 2 (sarà preferito numero superiore)           |                                           | 2    | 2    |
| Preferibilmente ripiani ad altezza regolabile                                                                                                                                     | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                            | SI                                        | 1    | 1    |
| Preferibilmente piano superiore utilizzabile come base d'appoggio                                                                                                                 | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                            | SI                                        | 1    | 1    |
| *Munito almeno di:                                                                                                                                                                | max punti 2 (sarà preferita dotazione superiore)        |                                           | 2    | 2    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto bottiglietta endoscopi;</li> <li>• Supporto connettori endoscopi/ telecamera;</li> <li>• Braccio snodato per monitor</li> </ul> |                                                         |                                           |      |      |
| Preferibilmente dotato di maniglia di movimentazione                                                                                                                              | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                            | SI                                        | 1    | 1    |
| Ulteriori accessori a corredo dell'intera fornitura                                                                                                                               | max punti 3 (saranno valutati quantitativi e tipologie) | SUFFICIENTE<br>Minimo numero di accessori | 0,75 | 3    |
| <b>Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)</b>                                                                                                                       |                                                         |                                           |      |      |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato                                                                                                           | max 3 punti                                             | OTTIMO                                    | 3    | 2,25 |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                                                                                                                                | max 2 punti                                             | SUFFICIENTE                               | 0,5  | 2    |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata                                                                                                                       | max 2,5 punti                                           | SUFFICIENTE                               | 0,62 | 2,5  |
| Fornitura muletti sostitutivi                                                                                                                                                     | max 2,5 punti                                           | OTTIMO                                    | 2,5  | 2,5  |

**Totale 55,24      Totale 60,49**

*[Signature]*

**Lotto 9 Sistema riunito da visita ORL (60 punti su 70) – q.tà 2**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                                         | VE.DI.SE. HOSPITAL                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                    | compilare                                                                                                                                                                                | punti |
| *Dotato di aspiratore con ON/OFF automatico da almeno 40 l/min              | max punti 3 (sarà preferita capacità superiore)                                                                                                                                    | Ottimo                                                                                                                                                                                   | 3     |
| Sistema di aspirazione silenzioso e privo di vibrazioni                     | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                       | 0     |
| Scalda specchietti con temporizzazione variabile comandata elettronicamente | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                       | 2     |
| Cestino portarifiuti con sistema di apertura non manuale                    | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                       | 2     |
| *Dotato di almeno 2 fonti di luce a LED                                     | max punti 2 (sarà preferito quantitativo superiore)                                                                                                                                | ha il minimo richiesto (2 fonti) ed essendo il massimo punteggio pari a 2 (che dovrebbe essere attribuito a riuniti con 3, 4, o più fonti luce) si ritiene opportuno non dare il massimo | 1,5   |
| *Dotato di telecamera direttamente collegabile al PC                        | max punti 3 (saranno valutate dimensioni e risoluzione)                                                                                                                            | telecamera non 4k                                                                                                                                                                        | 2     |
| Telecamera alimentata a bassissima tensione                                 | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                       | 2     |
| *Dotato di monitor da almeno 21"                                            | max punti 3 (sarà prediletta dimensioni superiori)                                                                                                                                 | monitor di 23,8 quindi appena superiore al minimo richiesto                                                                                                                              | 1     |
| Munito di PC di ultima generazione                                          | max punti 3 (saranno esaminate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>o CPU;<br>o Sistema operativo;<br>o Capacità ram;<br>o Monitor;<br>o Mouse e tastiera wireless) | Ottimo                                                                                                                                                                                   | 3     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Av. 9  
*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Software integrato per acquisizione video                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>max punti 4 (saranno considerate:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacità di memoria;</li> <li>Facilità di utilizzo;</li> <li>Importazione di esami salvati in formato digitale (es. tac);</li> <li>Salvataggio di video e immagini dei test effettuati;</li> <li>Creazione di stampe personalizzabili su richiesta dell'operatore;</li> <li>Capacità di impostare direttamente i dati del paziente utilizzando il lettore di tessera sanitaria)</li> </ul> </li> </ul> | Discreto<br><br>Capacità di memoria limitata; non è possibile creare stampe personalizzate; manca lettore di smart card | 2   |
| *Fornito di adeguati supporti con , dove necessario, sistema di antiappannamento per: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nasofaringoscopia;</li> <li>Endoscopio flessibile;</li> <li>Testa della telecamera;</li> <li>Caschetto;</li> <li>Monitor</li> </ul> | max punti 3 (sarà preferito maggior numero di supporti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non sono presenti tutti i supporti richiesti                                                                            | 2   |
| *Dotato di almeno N° 4 ruote antistatiche piroettanti di cui almeno N° 2 con sistema di blocco                                                                                                                                                                   | max punti 2 (sarà preferito sistema frenante su ogni ruota)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sufficiente<br><br>Manca sistema di blocco                                                                              | 0,5 |
| *Dotato di almeno N° 4 cassette                                                                                                                                                                                                                                  | max punti 1 (sarà preferito numero superiore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                       | 0   |
| *Dimensioni                                                                                                                                                                                                                                                      | max punti 2 (saranno preferiti ingombri ridotti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sufficiente<br><br>Non adeguate all'utilizzo                                                                            | 0,5 |
| *Peso                                                                                                                                                                                                                                                            | max punti 2 (sarà preferito peso ridotto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sufficiente<br><br>Non adeguato all'utilizzo                                                                            | 0,5 |
| *Dotato di poltrona con regolazione elettrica                                                                                                                                                                                                                    | max punti 4 (sarà preferita regolazione indipendente di: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seduta;</li> <li>Schienale;</li> <li>Salita/discesa;</li> <li>Gambale)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ottimo                                                                                                                  | 4   |
| *Possibilità di memorizzare le configurazioni della poltrona più usate                                                                                                                                                                                           | max punti 1,5 (sarà preferita possibilità di memorizzare elevato numero di configurazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                       | 0   |
| *Rotazione della poltrona a destra e sinistra                                                                                                                                                                                                                    | max punti 1,5 (sarà preferito angolo di rotazione maggiore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 1,5 |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
A. P.  
Bevati

|                                                                                                          |                                                           |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Poltrona configurabile come un lettino visita                                                            | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                              | SI              | 2    |
| Poltrona con tappezzeria in materiale resistente agli strappi e facile da pulire e disinfettare          | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                              | SI              | 1    |
| Poltrona dotata di poggiatesta                                                                           | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                              | SI              | 1    |
| Poltrona munita di braccioli imbottiti                                                                   | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                          | SI              | 0,5  |
| Controllo da remoto della poltrona paziente                                                              | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                              | NO              | 0    |
| Poltrona in grado di raggiungere la posizione trendelenburg (-20°) in autonomia tramite un unico comando | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                              | NO              | 0    |
| Sgabello con rivestimento in materiale resistente, facile da pulire e disinfettare                       | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                              | SI              | 1    |
| Sgabello con ruote piroettanti dotate di freno                                                           | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                              | SI              | 1    |
| Sgabello con appoggio dorsale                                                                            | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                              | SI              | 1    |
| Sgabello con poggiatesta cromato                                                                         | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                              | NO              | 0    |
| *Sgabello con altezza regolabile                                                                         | max punti 1,5 (sarà preferito ampio range di regolazione) |                 | 1,5  |
| *Ulteriori accessori a corredo                                                                           | max punti 4 (saranno valutate tipologie e quantità)       | 0               | 0    |
| <b>Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)</b>                                              |                                                           |                 |      |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato                                  | max 3 punti                                               | Non sufficiente | 0    |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                                                       | max 2 punti                                               | Ottimo          | 2    |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata                                              | max 2,5 punti                                             | Buono           | 1,87 |
| Fornitura muletti sostitutivi                                                                            | max 2,5 punti                                             | Non sufficiente | 0    |

**Totale 40,37**




*Aut*  
*Relet*

**Lotto 10 Oftalmoscopio binoculare indiretto (60 punti su 70) – q.tà 2**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                                                                   | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                                                                                                                          | TEC MED S.r.l.                                           |       | MEDIKA VISION                                            |       | OPTARISTON OFTALMOLOGIA                                  |       | BIOPHISICA S.r.l.                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | compilare                                                | punti | compilare                                                | punti | compilare                                                | punti | compilare                         | punti |
| *Durata dei LED                                                                                                                                                | max punti 6 (sarà preferita durata superiore)                                                                                                                                                                                                                       | 10.000                                                   | 0     | 10.000                                                   | 0     | 10.000                                                   | 0     | 20.000                            | 6     |
| *Alimentazione a batteria di lunga durata                                                                                                                      | max punti 6 (sarà preferita durata superiore)                                                                                                                                                                                                                       | 6-11h                                                    | 0     | 6-11h                                                    | 0     | 6-11h                                                    | 0     | 20h                               | 6     |
| Ricarica delle batterie                                                                                                                                        | max punti 6 (sarà valutato il sistema con particolare interesse verso:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brevi tempi di ricarica;</li> <li>○ Facilità di utilizzo: semplicità di posizionamento nella stazione di ricarica e nel rimontaggio )</li> </ul> | 1,5h ottimo                                              | 6     | 1,5h ottimo                                              | 6     | 1,5h ottimo                                              | 6     | 2h discreto                       | 3     |
| *Possibilità di visualizzare il fondo con diverse dimensioni della pupilla                                                                                     | max punti 6 (sarà preferito range dimensionale più ampio)                                                                                                                                                                                                           | 1mm-10mm                                                 | 6     | 1mm-10mm                                                 | 6     | 1mm-10mm                                                 | 6     | 1mm-10mm                          | 6     |
| Sistema di regolazione della distanza interpupillare                                                                                                           | max punti 6 (saranno considerate in particolare:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ Facilità di utilizzo;</li> <li>○ Range di regolazione)</li> </ul>                                                                                                      | Ottimo 48-76 (8mm)                                       | 6     | Ottimo 48-76 (8mm)                                       | 6     | Ottimo 48-76 (8mm)                                       | 6     | Ottimo 46-74mm (8mm)              | 6     |
| *Possibilità di scegliere almeno tra le seguenti tipologie di filtri:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Blu;</li> <li>• Diffusore di luce</li> </ul> | max punti 6 (sarà prediletto numero superiore di filtri)                                                                                                                                                                                                            | 3 - Blu cobalto, chiaro, rosso privo (verde), +diffusore | 6     | 3 - Blu cobalto, chiaro, rosso privo (verde), +diffusore | 6     | 3 - Blu cobalto, chiaro, rosso privo (verde), +diffusore | 6     | 3- Giallo, verde, blu + diffusore | 6     |

Al. 13  
Bened

*[Handwritten signature]*

|                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Portaletti per portatori di occhiali;                                   | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                               | si                                                                                                                                                                                                                          | 3   | si                                                                                                                                                                                                                          | 3   | 3                                                                                                                                                                                                                           | si                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                             | no    | 0   |
| *Regolazione della luminosità                                           | max punti 5 (sarà preferito ampio range)                   | 0-max                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 0-max                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 5                                                                                                                                                                                                                           | 0-max               | 5                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                             | 0-max | 5   |
| *Regolazione delle dimensioni                                           | max punti 6 (sarà preferito range maggiormente elevato)    |                                                                                                                                                                                                                             | 6   |                                                                                                                                                                                                                             | 6   | 6                                                                                                                                                                                                                           |                     | 6                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                             |       | 6   |
| *Peso                                                                   | max punti 3 (sarà preferito peso ridotto)                  | 596 g                                                                                                                                                                                                                       | 0   | 596 g                                                                                                                                                                                                                       | 0   | 0                                                                                                                                                                                                                           | 596 g               | 0                                                                                                                                                                                                                           | 470 gr.(strumento)                                            | 3     | 3   |
| Ergonomia                                                               | max punti 3 (sarà preferita maggiore facilità di utilizzo) | ottimo                                                                                                                                                                                                                      | 3   | ottimo                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 3                                                                                                                                                                                                                           | ottimo              | 3                                                                                                                                                                                                                           | Discreto<br>Batteria scorporata dal caschetto                 | 1,5   | 1,5 |
| *Accessori a corredo                                                    | max punti 4 (saranno valutate tipologie e quantità)        | Alimentatore a rete<br>Caricatore a muro<br>n.2 batterie Slimline<br>(di cui una di riserva)<br>Lente HIMagTM1.6x<br>(Brevettata)<br>Specchietto didattico<br>Copri oculari in gomma<br>n.2 lenti addizionali +2 D<br>Tot 9 | 4   | Alimentatore a rete<br>Caricatore a muro<br>n.2 batterie Slimline<br>(di cui una di riserva)<br>Lente HIMagTM1.6x<br>(Brevettata)<br>Specchietto didattico<br>Copri oculari in gomma<br>n.2 lenti addizionali +2 D<br>Tot 9 | 4   | Alimentatore a rete<br>Caricatore a muro<br>n.2 batterie Slimline<br>(di cui una di riserva)<br>Lente HIMagTM1.6x<br>(Brevettata)<br>Specchietto didattico<br>Copri oculari in gomma<br>n.2 lenti addizionali +2 D<br>Tot 9 | 4                   | Alimentatore a rete<br>Caricatore a muro<br>n.2 batterie Slimline<br>(di cui una di riserva)<br>Lente HIMagTM1.6x<br>(Brevettata)<br>Specchietto didattico<br>Copri oculari in gomma<br>n.2 lenti addizionali +2 D<br>Tot 9 | Accumulatore<br>caricatore<br>Adattatore<br>angolato<br>Tot 3 | 0     | 0   |
| Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |       |     |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti                                                | 0 mesi<br>Insufficiente                                                                                                                                                                                                     | 0   | 0 mesi<br>Insufficiente                                                                                                                                                                                                     | 0   | 60 mesi<br>ottimo                                                                                                                                                                                                           | 30 mesi<br>discreto | 3                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                             | 1,5   | 1,5 |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti                                                | 24h buono                                                                                                                                                                                                                   | 1,5 | 48h sufficiente                                                                                                                                                                                                             | 0,5 | 4h ottimo                                                                                                                                                                                                                   | 4h ottimo           | 2                                                                                                                                                                                                                           | 4h ottimo                                                     | 2     | 2   |

*[Signature]*

*[Signature]*

Bentini  
A.G. 12

|                                                             |               |             |      |                              |   |           |      |            |     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------------------------|---|-----------|------|------------|-----|
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata | max 2,5 punti | 24/48 buono | 1,87 | Insufficiente                | 0 | 24h buono | 1,87 | 12h ottimo | 2,5 |
| Fornitura muletti sostitutivi                               | max 2,5 punti | Si ottimo   | 2,5  | Insufficiente<br>Non Forniti | 0 | Si ottimo | 2,5  | Si ottimo  | 2,5 |

|        |       |        |       |        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Totale | 50,87 | Totale | 45,50 | Totale | 54,37 | Totale | 57,00 |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|

puta

2

**Lotto 11 Campimetro (60 punti su 70) – q.tà 2**

Al. 11

*Scrub*

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                             | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)          | CARL ZEISS S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | TEC MED S.r.l. |       | OPTARISTON OFTALMOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | BIOPHISICA S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                          |                                                     | compilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | punti | Compilare      | punti | compilare                                                                                                                                                                                                                                                                                       | punti | compilare                                                                                                                                                                                                                                          | punti |
| Preferibilmente dotato di tracciamento oculare digitale                  | max punti 5 (SI = 5; NO = 0)                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | SI             | 5     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | SI                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     |
| *Possibilità di estendere l'analisi completa fino ad almeno 60° centrali | max punti 7 (sarà preferito valore superiore)       | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     | SI             | 7     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     | SI                                                                                                                                                                                                                                                 | 7     |
| *Dotato di un'ampia libreria di test predefiniti                         | max punti 7 (sarà preferito ampiezza superiore)     | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     | 32             | 7     | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     | 27                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     |
| *Possibilità di effettuare almeno le seguenti tipologie di test:         | max punti 7 (sarà preferito maggior numero di test) | LI Modalità del test di screening: Corretto per età, relativo a soglia, intensità singola.<br>Libreria test di soglia: Centrale 24-2, Centrale 30-2 (30°), Centrale 10-2, Macula, 60-4 (60°) periferico, Salto Nasale.<br>Strategie del test di soglia: SITA STANDARD, SITA FAST, SITA FASTER, SOGLIA PIENA, FASTPAC, I24-2C SITA FASTER | 7     | 32             | 7     | Tipologia test effettuabili: Campo analizzabile con pattern radiali e ortogonali, 10-2, 24-2, 30-2, G1, M1, O7, B1, FF-20, strategie di soglia, soglia veloce, soglia avanzata, soglia dinamica, Zeta, Zeta fast, BSV, Flicker, Esterman, Ginzarian Gandolfo, perimetria cinetica, GHT, Bebler. | 7     | Libreria test di soglia: Centrale 24-2, Centrale 30-2 (30°), Centrale 10-2, Macula, 60-4 (60°) periferico, Salto Nasale. neurologico Test speciali Patente, Medicina legale, mon oculare, binoculare Periferica Test cinetici Blu-su-Giallo (SWAP) | 0     |

*Luca*

*8*

*0*

|                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |   |                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                           |      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| *Stimoli                 | max punti 6 (sarà preferito maggior numero di stimoli disponibili)                                                                                | Bianco su Bianco, Rosso su Bianco, Blu su Bianco<br>3                                                                                                                             | 0 | Bianco, Verde, Blu, Rosso<br>4                                         | 6    | Bianco, blu, verde, rosso<br>4                                                                                                                                                                                                                                                          | 6    | Bianco, verde, rosso blu<br>4                                                                                                             | 6    |
| *Dotato di display LCD   | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche con particolare riferimento a:<br>o Touch screen;<br>o Dimensioni;<br>o Parametri controllabili) | Monitor LCD con Touch Screen da 15" Tutti i parametri<br>buono                                                                                                                    | 0 | No<br>Requisito minimo Pc associato<br>sufficiente                     | 0    | Display LCD touch-screen da 21.5" a colori Tutti i Parametri<br>ottimo                                                                                                                                                                                                                  | 7    | Display LCD touch screen 21" Tutti i parametri<br>ottimo                                                                                  | 6,46 |
| Ergonomia                | max punti 4 (saranno predilette semplicità, intuitività e facilità di utilizzo)                                                                   | ottimo                                                                                                                                                                            | 4 | Ottimo                                                                 | 4    | Ottimo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | Ottimo                                                                                                                                    | 4    |
| *Sistema di data storage | max punti 7 (sarà prediletta capacità superiore)                                                                                                  | 500 G<br>ottimo                                                                                                                                                                   | 7 | PC-All-in-One esterno collegato mediante un solo cavo USB<br>buono     | 5,25 | 256 G                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,25 | PC Integrato                                                                                                                              | 5,25 |
| *Dimensioni              | max punti 2 (saranno preferite dimensioni inferiori)                                                                                              | 126,672                                                                                                                                                                           | 2 | 141,207                                                                | 0,82 | 141,878                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,77 | 151,427                                                                                                                                   | 0    |
| *Peso                    | max punti 2 (sarà preferito peso inferiore)                                                                                                       | 28,7                                                                                                                                                                              | 0 | 17                                                                     | 2    | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,97 | 18                                                                                                                                        | 1,83 |
| *Accessori a corredo     | max punti 6 (saranno considerate quantità e tipologie)                                                                                            | 11<br>Tastiera con mousepad<br>• Copertina antipolvere<br>• Tavolo ergonomico a sollevamento elettrico adatto anche per pazienti in sedia a rotelle<br>• Stampante Laser a colori | 6 | Tavolo a sollevamento elettrico, PC All in one e stampante e copertina | 0    | Pulsante di risposta del paziente Supporto del pulsante di risposta del paziente Cavo di alimentazione n.2 Occlusori Copertura antipolvere Set salviette per mentoniera e poggiatesta Software dedicato PC (Integrato) Monitor Touch screen 21.5" Full HD (o superiore) Stampante laser | 2,57 | Pulsante di risposta del paziente Cavo Mascherine oculari - 2 pcs. Fusibili di ricambio - 2 pcs. Manuale operativo Copertura Set igienico | 1,71 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A.U.M. Beruati

|                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                   |      |                     |                                                                                                         |                     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--|
|                                                                         |               | <ul style="list-style-type: none"><li>Trasformatore d'isolamento medicale per stampante</li><li>2 Occlusori oculari Salviettine di pulizia</li><li>Piccola cassettera solidale al tavolo</li><li>2 fusibili di ricambio per tavolo</li><li>Lampadina di scorta</li></ul> |      |                   |      |                     | monocromatica<br>Tavolo a sollevamento elettrico accessibile ai disabili<br>Trasformatore di isolamento |                     |     |  |
| Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                   |      |                     |                                                                                                         |                     |     |  |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti   | 0 mesi<br>Insuff                                                                                                                                                                                                                                                         | 0    | 0 mesi<br>Insuff  | 0    | 30 mesi<br>Discreto | 1,5                                                                                                     | 30 mesi<br>Discreto | 1,5 |  |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti   | 7h<br>buono                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,5  | 24h<br>discreto   | 1    | 4h<br>ottimo        | 2                                                                                                       | 4h<br>ottimo        | 2   |  |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata             | max 2,5 punti | 22h<br>buono                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,18 | 24/48<br>discreto | 1,25 | 24h<br>buono        | 1,18                                                                                                    | 12h<br>ottimo       | 2,5 |  |
| Fornitura muletti sostitutivi                                           | max 2,5 punti | si                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5  | No Insuff         | 0    | Si                  | 2,5                                                                                                     | Si                  | 2,5 |  |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

46.12

**Lotto 12 Ottotipo a proiezione (60 punti su 70) - q.tà 6**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                        | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                                                                       | TEC MED S.r.l.  |       | MEDIKA VISION |       | OPTARISTON OFTALMOLOGIA |       | BIOPHISICA S.r.l. |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | compilare       | punti | compilare     | punti | compilare               | punti | compilare         | punti |
| *Possibilità di eseguire un'ampia gamma di test                                     | max punti 6 (sarà preferito numero maggiore)                                                                                                                     | 42              | 6     | 40            | 4,8   | 32                      | 0     | 40                | 4,8   |
| Possibilità di effettuare test con simboli per bambini                              | max punti 4 (SI = 4; NO = 0)                                                                                                                                     | SI              | 4     | SI            | 4     | SI                      | 4     | SI                | 4     |
| Dotato di sistema per scegliere e cambiare rapidamente i test                       | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche del sistema con particolare attenzione a:<br>o Rapidità;<br>o Semplicità d'utilizzo;<br>o Controllo a distanza) | Ottimo          | 7     | Ottimo        | 7     | Ottimo                  | 7     | Ottimo            | 7     |
| *Distanza di proiezione variabile all'interno di un ampio range                     | max punti 6 (sarà preferito range più ampio)                                                                                                                     | 2,5-8 mt<br>5,5 | 6     | 2-7 mt<br>5   | 0     | 2,8-8 mt<br>5,2         | 2,4   | 2-7 mt<br>5       | 0     |
| *Sorgente ad elevata luminosità per la corretta visualizzazione dei test proiettati | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>o Luminosità;<br>o Possibilità di regolazione;<br>o Durata della fonte luce)   |                 | 7     |               | 7     |                         | 7     |                   | 7     |

Beval

At. 12

| Dotato di zoom per adattare la proiezione alla distanza                 | max punti 6 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>o Valore;<br>o Tipologia;<br>o Regolazione) | 30x<br>Ottimo                                                        | 6    | 30x<br>Ottimo                                                            | 6 | 30x<br>Ottimo                                                                                               | 6    | 30x<br>Ottimo                                                       | 6   | 30x<br>Ottimo | 6   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|
| *Movimentazione rispetto alla base                                      | max punti 7 (sarà preferito maggior numero di movimenti e con range più ampi)                                                 | Non deducibile                                                       | 0    | 15°                                                                      | 0 | 20°                                                                                                         | 7    | 15°                                                                 | 0   |               | 0   |
| *Consumi                                                                | max punti 5 (sarà preferito consumo ridotto)                                                                                  | 60 VA                                                                | 3,63 | 45 VA                                                                    | 5 | 100 VA                                                                                                      | 0    | 45 VA                                                               | 5   |               | 5   |
| Spegnimento automatico                                                  | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                  | SI                                                                   | 2    | SI                                                                       | 2 | SI                                                                                                          | 2    | SI                                                                  | 2   |               | 2   |
| *Dimensioni                                                             | max punti 3 (sarà preferito sistema più compatto)                                                                             | 176,46                                                               | 0    | 106,80                                                                   | 3 | 121,21                                                                                                      | 2,38 | 106,80                                                              | 3   |               | 3   |
| *Peso                                                                   | max punti 3 (sarà preferito sistema più leggero)                                                                              | 4,7                                                                  | 1,35 | 3,6                                                                      | 3 | 5,6                                                                                                         | 0    | 3,6                                                                 | 3   |               | 3   |
| *Accessori a corredo                                                    | max punti 4 (saranno valutate quantità e tipologie)                                                                           | Telecomando, Batterie, Base, Schermo, Copertina, Cavo alimentazione. | 4    | 1 Foderina<br>1 Schermo metallico polarizzato<br>2 Fusibili e 2 Batterie | 4 | Telecomando<br>Supporto da tavolo<br>Schermo antiriflesso<br>Copertina antipolvere<br>Cavo di alimentazione | 4    | Telecomando<br>Schermo<br>Copertina<br>2 Fusibili<br>2 Pile<br>Cavo | 4   |               | 4   |
| Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)                    |                                                                                                                               |                                                                      |      |                                                                          |   |                                                                                                             |      |                                                                     |     |               |     |
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti                                                                                                                   | 24 m<br>insuff                                                       | 0    | 24m<br>insuff                                                            | 0 | 30m<br>Discreto                                                                                             | 1,5  | 30m<br>Discreto                                                     | 1,5 |               | 1,5 |
| Tempo di intervento dalla ricezione                                     | max 2 punti                                                                                                                   | 24h                                                                  |      | 2gg                                                                      |   | 4h                                                                                                          |      | 4h                                                                  |     |               |     |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

AV. 12

| della chiamata                                              |               | buono           | 1,5  | suffic | 0,5 | ottimo    | 2    | ottimo     | 2   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|--------|-----|-----------|------|------------|-----|
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata | max 2,5 punti | 24-48h discreto | 1,25 | insuff | 0   | 24h buono | 1,87 | 12h ottimo | 2,5 |
|                                                             | max 2,5 punti | Si ottimo       | 2,5  | Insuff | 0   | Si ottimo | 2,5  | Si ottimo  | 2,5 |
| Fornitura muletti sostitutivi                               |               |                 |      |        |     |           |      |            |     |

Totale 52,23    Totale 46,30    Totale 46,95    Totale 54,30

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Bovali*

*Handwritten signature*

**Lotto 13 Frontofocometro (60 punti su 70) – q.tà 5**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                          | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                      | CARL ZEISS S.p.A.                          |       | TEC MED S.r.l.                            |       | MEDICA VISION                                 |       | OPTARISTON OFTALMOLOGIA               |       | BIOPHISICA S.r.l.                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                                                       |                                                                                                                 | compiare                                   | punti | compiare                                  | punti | compiare                                      | punti | compiare                              | punti | compiare                                 | punti |
| *Lenti singole fino a 70 mm di diametro                                                               | max punti 7 (sarà preferito range superiore)                                                                    | 81,8                                       | 0     | 120                                       | 7     | 100                                           | 3,33  | 120                                   | 7     | 100                                      | 3,33  |
| Preferibilmente funzione di riconoscimento automatico delle lenti progressive                         | max punti 6 (SI = 6; NO = 0)                                                                                    | SI                                         | 3     | SI                                        | 3     | SI                                            | 3     | SI                                    | 3     | SI                                       | 3     |
| *Adatto alla misurazione di lenti con elevato indice di rifrazione                                    | max punti 7 (sarà preferito range più ampio con valori maggiormente elevati)                                    | SI                                         | 7     | SI                                        | 7     | SI                                            | 7     | SI                                    | 7     | SI                                       | 7     |
| *Range di misura:                                                                                     | max punti 7 (saranno preferiti range maggiori)                                                                  | +/- 25D<br>±10D<br>0° a 180°<br>da 0 a 20Δ | 7     | +/- 25D<br>+/- 10D<br>0°-180°<br>0 ~ 20 Δ | 7     | +/- 25D<br>+/- 10D<br>0°-180°<br>da 0-10.00 Δ | 0     | ±25 D<br>±10 D<br>0 ÷ 180°<br>0 ÷ 15Δ | 3,5   | +/- 25 D<br>+/- 10 D<br>0-180°<br>0-10 Δ | 0     |
| • Sfera: ± 25 D;<br>• Cilindro: [0, 10] D;<br>• Assi del cilindro: [0°, 180°];<br>• Prisma: [0, 10] Δ |                                                                                                                 |                                            |       |                                           |       |                                               |       |                                       |       |                                          |       |
| *Dotato di monitor a colori                                                                           | max punti 7 (saranno valutate le caratteristiche con particolare riferimento a:<br>Dimensioni;<br>Touch screen) | Touch Screen<br>7"                         | 7     | Touch screen<br>LCD da 7"                 | 7     | LCD 7" a colori, touch screen                 | 7     | 7" Wide TFT a colori touch-screen     | 7     | 5,7"                                     | 0     |
| Possibilità di tilting del display                                                                    | max punti 6 (SI = 6; NO = 0)                                                                                    | SI                                         | 6     | SI                                        | 6     | SI                                            | 6     | SI                                    | 6     | SI                                       | 6     |
| Possibilità di trasmettere dati a PC                                                                  | max punti 6 (saranno valutate semplicità e velocità di trasmissione)                                            | Ottimo                                     | 6     | Ottimo                                    | 6     | Ottimo                                        | 6     | Ottimo                                | 6     | Ottimo                                   | 6     |
| *Dimensioni                                                                                           | max punti 2 (saranno preferite dimensioni inferiori)                                                            | 236,43                                     | 0     | 203,74                                    | 0,59  | 223,94                                        | 0,22  | 194,01                                | 0,77  | 126,77                                   | 2     |

*Barat*

*2*

*Luca*

| *Peso               | max punti 2 (sarà preferito e peso inferiore)                                | 6kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 5kg                                                                         | 1,11 | Non rilevato                       | 0 | 5,5kg                                                                                                                                                                                                                           | 0,55 | 4,2kg                                                                        | 2 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Interfaccia         | max punti 4 (sarà prediletta interfaccia maggiormente semplice ed intuitiva) | Ottimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | Ottimo                                                                      | 4    | Ottimo                             | 4 | Ottimo                                                                                                                                                                                                                          | 4    | Ottimo                                                                       | 4 |
| Accessori a corredo | max punti 6 (saranno valutate quantità e tipologie)                          | Ottimo<br>- Rivestimento protettivo contro la polvere<br>- 2 Fusibili<br>- Cavo di alimentazione<br>- Soffietto<br>- Supporto per lenti<br>- Supporto per lenti a contatto<br>- Un rotolo di carta per stampante termica<br>- Unità USB con licenza temporanea FORUM LINK per la connessione di rete<br>- Cavo LAN Ethernet<br>- Istruzioni per l'uso in italiano<br>- Tavolo porta strumento ad elevazione elettrica | 6 | Discreto<br>Cavo<br>Supporto lenti a contatto<br>Copertina<br>Manuale d'uso | 3    | Insufficiente<br>Non<br>Deducibile | 0 | Buono<br>Cavo di alimentazione<br>Supporto protettivo per lenti<br>Supporto protettivo per lenti a contatto<br>Supporto per lenti a contatto rigide<br>Carta per stampante (3 rotoli)<br>Copertina antipolvere<br>Manuale d'uso | 4,5  | Discreto<br>Cavo<br>Carta<br>Poggia lenti a contatto<br>Copertina<br>Manuale | 3 |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

*Bevati*

Al.13

Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)

|                                                                         | max 3 punti   | 24m<br>insufficiente | 0    | 24m<br>insufficiente | 0    | 24m<br>sufficiente | 0   | 30m<br>discreto | 1,5  | 30m<br>discreto | 1,5 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|----------------------|------|--------------------|-----|-----------------|------|-----------------|-----|
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato |               |                      |      |                      |      |                    |     |                 |      |                 |     |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti   | 8 h<br>buono         | 1,5  | 24h<br>Discreto      | 1    | 48h<br>sufficiente | 0,5 | 4h<br>ottimo    | 2    | 4h<br>ottimo    | 2   |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata             | max 2,5 punti | 24h<br>buono         | 1,87 | 24/48 h<br>buono     | 1,87 | ?<br>Insuff        | 0   | 24h<br>buono    | 1,87 | 12h<br>ottimo   | 2,5 |
| Fornitura muletti sostitutivi                                           | max 2,5 punti | Si ottimo            | 2,5  | ? Insuff             | 0    | ? Insuff           | 0   | Si ottimo       | 2,5  | Si ottimo       | 2,5 |

Totale 51,87      Totale 54,57      Totale 37,05      Totale 57,19      Totale 44,83

*[Signature]*

*[Signature]*

*Boratti*

73

**Lotto 14 Autorefrattometro con cheratometria (60 punti su 70) – q.tà 5**

Au.14

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                  | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste) |       | TEC MED S.r.l.       |       | MEDIKA VISION        |       | OPTARISTON OFTALMOLOGIA |       | BIOPHISICA S.r.l. |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|
|                                                               | compilare                                  | punti | compilare            | punti | compilare            | punti | compilare               | punti | compilare         | punti |
| *Idoneo ad effettuare misurazioni di:                         |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| • Refrattometria;                                             |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| • Cheratometria;                                              |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| • Refrattometria e Cheratometria combinata                    |                                            | 5     |                      |       |                      | 5     |                         | 5     |                   | 5     |
| *Dotato di display da almeno 5"                               |                                            |       | 7"                   | 4     | 7"                   | 4     | 5,7"                    | 0     | 5,7"              | 0     |
| Display a colori                                              |                                            |       | SI                   | 3     | SI                   | 3     | SI                      | 3     | SI                | 3     |
| *Provisto almeno dei seguenti range di misura:                |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| • Sfera: [-20; 20] D;                                         |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| • Cilindro: [0; 10] D;                                        |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| • Distanza interpupillare: [10; 85] mm;                       |                                            | 5     |                      |       |                      | 5     |                         | 3,75  |                   | 3,75  |
| • Astigmatismo corneale: [0; 15] D                            |                                            |       | (ottimo)             |       |                      |       | (buono)                 |       |                   |       |
| *Idoneo a misurare il diametro corneale                       |                                            |       | SI                   | 3     | SI                   | 2,25  | SI                      | 0     | No                | 0     |
| *Idoneo a misurare il diametro della pupilla                  |                                            |       | 2-14 mm (12mm)       |       | 2-12 mm (10mm)       |       | 10-14 mm (4mm)          |       |                   |       |
| Preferibilmente misurazione automatica del diametro pupillare |                                            |       | 2-10 mm              | 2     | 2-10 mm              | 2     | 1-10 mm                 | 3     | 2-8 mm            | 0     |
| Dotato delle seguenti modalità di misurazione:                |                                            |       | 8 mm                 |       | 8 mm                 |       | 9 mm                    |       | 6 mm              |       |
| o Automatica;                                                 |                                            |       | No                   | 0     | No                   | 0     | No                      | 0     | SI                | 3     |
| o Manuale;                                                    |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| o Modalità rapida per pazienti poco collaborativi             |                                            |       |                      |       |                      |       |                         |       |                   |       |
| *Preferibilmente dotato di memoria interna                    |                                            |       | SI                   | 3     | SI                   | 3     | SI                      | 3     | SI                | 3     |
|                                                               |                                            |       | 10 Valori per occhio | 4     | 10 Valori per occhio | 4     | 10 Valori per occhio    | 4     | ?                 | 0     |

*[Signature]*

8

*[Signature]*

71

|                                                                      |                                                                |                                                                                                |      |                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Preferibilmente dotato di mentoniera elettrica                       | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                   | SI                                                                                             | 3    | SI                                                    | 3    | SI                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | SI                                                                                                                                       | 3   | 3   |
| Possibilità di determinare la percentuale di opacità del cristallino | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                   | No                                                                                             | 0    | SI                                                    | 3    | No                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | No                                                                                                                                       | 0   | 0   |
| Utilizzabile su pazienti con impianto di cristallino artificiale     | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                   | SI                                                                                             | 3    | SI                                                    | 3    | SI                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | SI                                                                                                                                       | 3   | 3   |
| Calcolo automatico dell'astigmatismo residuo                         | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                   | No                                                                                             | 0    | No                                                    | 0    | No                                                                                                                                                                                                                                     | 0    | SI                                                                                                                                       | 3   | 3   |
| Funzione di stand by                                                 | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                   | SI                                                                                             | 3    | SI                                                    | 3    | SI                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | SI                                                                                                                                       | 3   | 3   |
| Facilità di utilizzo                                                 | max punti 3 (sarà preferita interfaccia semplice ed intuitiva) | Ottimo                                                                                         | 3    | Ottimo                                                | 3    | Ottimo                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | Ottimo                                                                                                                                   | 3   | 3   |
| *Ingombro \                                                          | max punti 1,5 (sarà preferito ingombro ridotto)                | 585                                                                                            | 1,19 | 649,68                                                | 0,64 | 724,68                                                                                                                                                                                                                                 | 0    | 547,67                                                                                                                                   | 1,5 | 1,5 |
| *Peso                                                                | max punti 1,5 (sarà preferito peso ridotto)                    | 20 Kg                                                                                          | 0    | 18 Kg                                                 | 1    | 17 Kg                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5  | 17 Kg                                                                                                                                    | 1,5 | 1,5 |
| *Accessori a corredo e/o opzionali con relative quantità             | max punti 3 (sarà preferito quantitativo maggiore)             | Occhio di prova, set cartine mentoniera, 2 chiodini mentoniera, copertina antipolvere, manuali | 0    | Cavo Occhio di Prova 2 Rotoli carta Copertina Manuale | 0    | Cavo di alimentazione Occhio di prova Kit cartine per mentoniera 2 Pin per cartine mentoniera Carta per stampante (3 rotoli) Supporto per lenti a contatto Copertina antipolvere Manuale d'uso CD installazione software DATA Transfer | 2,25 | Occhio di Prova Cavo 3 rotoli carta 2 Fusibili 1 Conf. Carta Mentoniera 2 Pin Cartine Coperta antipolvere PortalAC Manuale/USB CD Driver | 3   | 3   |
| Stampante termica incorporata                                        | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                   | SI                                                                                             | 3    | SI                                                    | 3    | SI                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | SI                                                                                                                                       | 3   | 3   |

Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)

|                                                                         |             |               |     |               |   |          |     |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|---|----------|-----|----------|-----|
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti | 24m           | 0   | 24m           | 0 | 30 m     | 1,5 | 30 m     | 1,5 |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti | Insufficiente | 1,5 | Insufficiente | 1 | Discreto | 2   | Discreto | 2   |

*[Signature]*

*[Signature]*

AV.14

|                                                             |               |                 |      |                 |   |           |      |            |     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------|---|-----------|------|------------|-----|
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata | max 2,5 punti | 24/48h discreto | 1,25 | X insufficiente | 0 | 24h Buono | 1,87 | 12h Ottimo | 2,5 |
| Fornitura muletti sostitutivi                               | max 2,5 punti | SI              | 2,5  | Insufficiente   | 0 | SI        | 2,5  | SI         | 2,5 |
| Totale                                                      |               | 50,44           |      | Totale          |   | 48,89     |      | Totale     |     |
|                                                             |               |                 |      |                 |   |           |      | 51,37      |     |
|                                                             |               |                 |      |                 |   |           |      | Totale     |     |
|                                                             |               |                 |      |                 |   |           |      | 50,25      |     |

mu/la

g

Forati

73

Al.15

8

**Lotto 15 Microscopio operatorio (60 punti su 70) – q.tà 2**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                                                                        | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                                                                      | CARL ZEISS S.p.A. |       | LEICA MICROSYSYSTEMS |       | TEC MED S.r.l. |       | OPTARISTON OFTALMOLOGIA |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                 | compilare         | punti | compilare            | punti | compilare      | punti | compilare               | punti |
| *Risoluzione delle ottiche                                                                                          | max punti 2 (sarà preferita risoluzione maggiore)                                                               |                   | 2     |                      | 2     |                | 2     |                         | 2     |
| *Profondità di campo                                                                                                | max punti 2 (sarà preferito valore superiore)                                                                   |                   | 2     |                      | 2     |                | 2     |                         | 2     |
| *Zoom motorizzato o manuale pari almeno a 1:4                                                                       | max punti 1,5 (saranno preferiti valori superiori)                                                              | Si 1:6            | 1,5   | Si 1:6               | 1,5   | Si 1:6         | 1,5   | Si 1:6                  | 1,5   |
| Zoom motorizzato e manuale                                                                                          | max punti 0,5 (Si = 0,5; NO =0)                                                                                 |                   |       |                      |       |                |       |                         |       |
| Ottiche apocromatiche                                                                                               | max punti 0,5 (Si = 0,5; NO =0)                                                                                 | Si                | 0,5   | Si                   | 0,5   | Si             | 0,5   | Si                      | 0,5   |
| *Dotato di oculari a grande campo 10x dotati di compensazione diottrica pari almeno a $\pm 5$                       | max punti 1,5 (sarà preferita compensazione maggiore)                                                           | Si                | 0,5   | Si                   | 0,5   | Si             | 0,5   | Si                      | 0,5   |
| *Messa a fuoco motorizzata all'interno di un range pari almeno a 55 mm                                              | max punti 2 (sarà preferito range maggiormente ampio)                                                           | Si 70mm           | 1,6   | Si +/-5 (10)         | 0     | Si +/-8 (13)   | 1,12  | Si +/- 7 (14)           | 1,5   |
| Possibilità di rendere la messa a fuoco dipendente dal fattore di ingrandimento in uso                              | max punti 0,5 (Si = 0,5; NO =0)                                                                                 | Si                | 0,5   | Si                   | 0,5   | No             | 0     | No                      | 0     |
| *Possibilità di movimentare il corpo ottico lungo il piano XY di almeno 60 mm                                       | max punti 2 (sarà preferito valore superiore)                                                                   | Si 61             | 1     | Si 62                | 2     | Si 60          | 0     | Si 60                   | 0     |
| Dotato di pannello di controllo touch screen con interfaccia grafica per impostare e gestire i parametri di sistema | max punti 1,5 (sarà preferito sistema semplice ed intuitivo in grado di gestire il maggior numero di parametri) | Si Ottimo         | 1,5   | Si Ottimo            | 1,5   | Si Ottimo      | 1,5   | Si Ottimo               | 1,5   |

*Sevati*

*[Signature]*

Al. 15

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     |                         |     |                                   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------------|------|------|
| Munito di pedaliera di controllo                                                                                                                   | max punti 2 (saranno valutate le caratteristiche con particolare riferimento a:<br>o N° funzioni programmabili<br>o N° tasti/joystick disponibili;<br>o Sistema wireless) | 2   | 2                       | 2   | 2                                 | 2    | 2    |
| *Preferibilmente tilt del corpo ottico per migliorare la visione                                                                                   | max punti 1 (sarà preferito tilt superiore)                                                                                                                               | 0   | Si 120                  | 0,2 | Si 160                            | 1    | 1    |
| Provisto di N° 2 tubi binoculari (chirurgo e assistente) con invertitore di immagine elettrico o manuale integrato all'interno del tubo binoculare | Si                                                                                                                                                                        | 2   | Si                      | 2   | Sistema non necessita inversione  | 2    | 2    |
| Osservatore laterale dotato della medesima stereopsi e profondità di campo del chirurgo principale                                                 | Si                                                                                                                                                                        | 1   | Si                      | 1   | Si                                | 1    | 1    |
| *Dispositivo dell'osservatore laterale ruotabile di circa 180°                                                                                     | 180°                                                                                                                                                                      | 1   | 180°                    | 1   | 160°                              | 0    | 0    |
| Preferibilmente illuminazione con filtro per temperatura di colore di tipo alogeno attivabile elettricamente                                       | Si                                                                                                                                                                        | 1   | Si                      | 1   | Si                                | 1    | 1    |
| *Luce coassiale a 0° con intensità regolabile dal chirurgo                                                                                         | Si<br>0-100%                                                                                                                                                              | 2   | Si<br>0-100%            | 2   | Si<br>0-100%                      | 2    | 2    |
| *Presenza o predisposto al montaggio di opportuni filtri                                                                                           | max punti 1,5 (sarà preferito numero superiore)                                                                                                                           | 1,5 | Si 4                    | 0   | Si 4                              | 0    | 0    |
| Dotato di telecamera                                                                                                                               | max punti 3 (saranno preferite:<br>• risoluzione superiore;<br>• videocamera integrata nel corpo ottico)                                                                  | 3   | Ottimo<br>Full Hd<br>Si | 3   | Buono<br>Full Hd<br>Camera a lato | 2,25 | 2,25 |
| Fornito di sistema di acquisizione e registrazione immagini ad alta definizione con storage interno di 1 TB e tramite USB                          | max punti 2 (Si = 2; NO = 0)                                                                                                                                              | 2   | Si                      | 2   | Si                                | 2    | 2    |

*[Signature]*

Bene

75

28

Al. 15

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |      |                                                                         |      |                                                                             |      |                                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| *Dotato di schermo di visualizzazione ad alta definizione integrato sullo stativo                    | max punti 3 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>o Dimensioni;<br>o Risoluzione;<br>o PC integrato "all in one")                                                                                                                                                                                          | 23,6"<br>HD<br>SI                              | 1,14 | 27"<br>HD<br>SI                                                         | 3    | 21,5<br>HD<br>SI                                                            | 0    | 21,5<br>HD<br>SI                                                            | 0    |
| *Provisto di sistema di visione panoramica dedicato                                                  | max punti 2,5 (saranno valutate le caratteristiche con particolare attenzione a:<br>• Messa a fuoco elettrica motorizzata;<br>• Pedale di comando;<br>• Lente per osservazione panoramica;<br>• Lente per osservazione macula;<br>• Sostituzione delle lenti senza interruzione della procedura;<br>• Inversione automatica dell'immagine) | Ottimo<br><br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI |      | ottimo<br><br>SI<br>SI<br>Lente 60-130°<br><br>Non Necessaria<br><br>SI |      | Discreto<br><br>No a Leva<br><br>SI<br>SI<br>No<br><br>Inversione Integrata |      | Discreto<br><br>No a Leva<br><br>SI<br>SI<br>No<br><br>Inversione Integrata |      |
| *Possibilità di memorizzare svariati set up                                                          | max punti 2 (sarà preferito numero superiore)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                             | 2    | 30                                                                      | 1,28 | 12                                                                          | 0    | 12                                                                          | 0    |
| *Dimensioni                                                                                          | max punti 1 (saranno preferiti ingombri ridotti)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121,82                                         | 0    | 92,60                                                                   | 1    | 112,28                                                                      | 0,32 | 112,28                                                                      | 0,32 |
| *Peso                                                                                                | max punti 1 (sarà preferito peso ridotto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240                                            | 1    | 350                                                                     | 0    | 251                                                                         | 0,9  | 251                                                                         | 0,9  |
| Continuum della procedura in atto in caso di guasto della lampada senza interruzione della chirurgia | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                             | 2    | SI                                                                      | 2    | SI                                                                          | 2    | SI                                                                          | 2    |
| Lampada a fessura regolabile tramite pedaliera o manopole                                            | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                             | 1    | SI                                                                      | 1    | SI                                                                          | 1    | SI                                                                          | 1    |
| Cheratiscopio integrato nel corpo ottico                                                             | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                             | 3    | SI                                                                      | 3    | Non Integrato                                                               | 0    | Non Integrato                                                               | 0    |
| Sistema di gestione di lenti toriche                                                                 | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                             | 1    | SI                                                                      | 1    | SI                                                                          | 1    | SI                                                                          | 1    |

*[Signature]*

*Belal*

76

20

AV.15

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                          |   |                                                                |                |                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Aggiornabile, anche in futuro, con OCT Intraoperatorio completamente interfacciato al microscopio e capace di consentire la scansione delle strutture oculari (sia segmento posteriore che anteriore dell'occhio) durante l'intervento chirurgico | max punti 3 (SI = 3; NO = 0)                        | SI                                                                                                                                                       | 3 | SI                                                                                                                                                       | 3 | No                                                             | 0              | No                                                             | 0    |
| Prova pratica                                                                                                                                                                                                                                     | max punti 7 (saranno valutate le prestazioni)       |                                                                                                                                                          | 7 |                                                                                                                                                          |   | 7                                                              | Non effettuata | Non effettuata                                                 | 0    |
| *Ulteriori accessori e software                                                                                                                                                                                                                   | max punti 3 (sarà preferito quantitativo superiore) | Cheratoscopio<br>Lampada a Fessura<br>Luce Fissazione<br>Paziente<br>Telecomando<br>sblocco Freni<br>Software<br>autodiagnosi<br>"altoparlanti<br>Ottimo | 3 | Cheratoscopio<br>Lampada a Fessura<br>Luce Fissazione<br>Paziente<br>Telecomando<br>sblocco Freni<br>Software<br>autodiagnosi<br>"altoparlanti<br>Ottimo | 3 | 2 Set Manopole<br>Copertina<br>Kit Pulizia<br>Manuale<br>buono | 2,25           | 2 Set Manopole<br>Copertina<br>Kit Pulizia<br>Manuale<br>buono | 2,25 |

Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70),35

|                                                                         |               |                      |     |                      |      |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----|----------------------|------|-----------------|------|
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato | max 3 punti   | 24m<br>insufficiente | 0   | 24m<br>insufficiente | 0    | 24m<br>discreto | 1,5  |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                      | max 2 punti   | 7h<br>buono          | 1,5 | 8h<br>buono          | 1,5  | 4h<br>Ottimo    | 2    |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata             | max 2,5 punti | 22h<br>ottimo        | 2,5 | 24h<br>buono         | 1,87 | 24h<br>buono    | 1,87 |
| Fornitura muletti sostitutivi                                           | max 2,5 punti | SI<br>ottimo         | 2,5 | ?<br>insufficiente   | 0    | SI<br>ottimo    | 2,5  |

Totale 60,86      Totale 57,85      Totale 35,84      Totale 39,34

Belvati

**Lotto 16 Sistema radiologico diretto multifunzione (60 punti su 70) - q.tà 1**

| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE                                    | PUNTEGGIO (rispetto alle minime richieste)                               | GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.                            |                     | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.            |                           | METALTRONICA                                |                           | GMS MED                                     |                     | TRADE ART 2000 S.p.A.                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                 |                                                                          | compilare                                                | punti               | compilare                                   | punti                     | compilare                                   | punti                     | compilare                                   | punti               | compilare                                   | punti                     |
|                                                                 |                                                                          | GENERATORE                                               |                     |                                             |                           |                                             |                           |                                             |                     |                                             |                           |
| *Generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 65 kW | max punti 6 (sarà preferita potenza superiore)                           | 80 kW                                                    | 6                   | 80 kW                                       | 6                         | 80 kW                                       | 6                         | 80 kW                                       | 6                   | 80 kW                                       | 6                         |
|                                                                 | *Corrente massima pari almeno ad 800 mA                                  | max punti 2 (sarà preferito range di valori superiore)   | 1000 mA             | 2                                           | 1000 mA                   | 2                                           | 1000 mA                   | 2                                           | 1000 mA             | 2                                           | 1000 mA                   |
| COMPLESSO RADIOGENO PENSILE                                     |                                                                          |                                                          |                     |                                             |                           |                                             |                           |                                             |                     |                                             |                           |
| *Escursione dei movimenti                                       | max punti 1 (saranno preferiti range di movimento maggiormente elevati)  | lon: 354 cm<br>tras: 277 cm<br>vert: 175 cm              | 0,75                | lon: 470 cm<br>tras: 330 cm<br>vert: 180 cm | 1                         | lon: 265 cm<br>tras: 240 cm<br>vert: 160 cm | 0,5                       | lon: 340 cm<br>tras: 240 cm<br>vert: 160 cm | 0,5                 | lon: 326 cm<br>tras: 202 cm<br>vert: 180 cm | 0,5                       |
|                                                                 | *Capacità termica dell'anodo non inferiore a 300 KHU                     | max punti 1 (sarà preferito valore maggiormente elevato) | 800 KHU             | 1                                           | 350 KHU                   | 0                                           | 600 KHU                   | 0,55                                        | 800 KHU             | 1                                           | 800 KHU                   |
| *Intervallo operativo di tensione                               | max punti 0,5 (sarà preferito range più ampio)                           | 40- 150 Kv                                               | 0,5                 | 40- 150 Kv                                  | 0,5                       | 40- 150 Kv                                  | 0,5                       | 40- 150 Kv                                  | 0,5                 | 40- 150 Kv                                  | 0,5                       |
|                                                                 | *Dimensioni delle macchie focali                                         | max punti 0,5 (saranno preferite dimensioni inferiori)   | 0,6 x 0,6<br>1x1 mm | 0,5                                         | 0,6 x 0,6<br>1,3 x 1,3 mm | 0                                           | 0,6 x 0,6<br>1,2 x 1,2 mm | 0,16                                        | 0,6 x 0,6<br>1x1 mm | 0,5                                         | 0,6 x 0,6<br>1,2 x 1,2 mm |
| *Dotato di monitor LCD touch screen da almeno 5"                | max punti 0,5 (sarà preferito monitor a colori con dimensioni superiori) | SI<br>10,4"                                              | 0,35                | SI<br>6,5"                                  | 0                         | SI<br>6,5"                                  | 0                         | SI<br>12,1"                                 | 0,5                 | SI<br>8,4"                                  | 0,17                      |
|                                                                 | Collimatore automatico e manuale con controllo indipendente delle lame   | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                         | si                  | 0,5                                         | si                        | 0,5                                         | si                        | 0,5                                         | si                  | 0,5                                         | si                        |
| Preview delle immagini                                          | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                         | si                                                       | 0,5                 | si                                          | 0,5                       | si                                          | 0,5                       | no                                          | 0                   | si                                          | 0,5                       |

*Donati*

*Rece*

*7/3*

Av. 16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Bocelli

79

*[Handwritten signature]*

| TAVOLO                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                         |      |                  |      |                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| Dotato di telecomando                                                                          | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                                                                                       | si               | 0,5  | no                                      | 0    | si               | 0,5  | no               | 0    |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                         |      |                  |      |                  |      |
| TAVOLO                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                         |      |                  |      |                  |      |
| *Portata non inferiore a 250 Kg                                                                | max punti 0,5 (sarà preferita portata superiore)                                                                                                                                       | 280 kg           | 0,1  | 400 kg                                  | 0,5  | 300 kg           | 0,17 | 250 kg           | 0    |
| *Tavolo elevabile con altezza minima non superiore a 57 cm                                     | max punti 1,5 (sarà preferita altezza minima inferiore)                                                                                                                                | 47 cm            | 1,25 | 50 cm                                   | 0,87 | 57 cm            | 0    | 45 cm            | 1,37 |
| *Possibilità di controllare i movimenti mediante pedaliera o pulsantiera                       | max punti 0,5 (sarà preferito maggior numero di parametri)                                                                                                                             | SI               | 0,5  | SI                                      | 0,5  | SI               | 0,5  | SI               | 0,5  |
| Pedaliera wireless                                                                             | max punti 0,5 (SI = 0,5; NO = 0)                                                                                                                                                       | NO               | 0    | SI                                      | 0,5  | NO               | 0    | SI               | 0,5  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                         |      |                  |      |                  |      |
| TELERADIOGRAFO                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                         |      |                  |      |                  |      |
| *Dotato di sistema motorizzato per movimentazione verticale                                    | max punti 1 (sarà prediletto più ampio range di movimento)                                                                                                                             | 140,4 cm         | 0    | 150 cm. (maggiore range verticale)      | 1    | 142 cm           | 0,06 | 160 cm.          | 0,8  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                  |      | 125 cm. (range braccio portarilevatore) |      |                  |      |                  |      |
| *Potter-bucky inclinabile all'interno del range [0°, 90°]                                      | max punti 1 (sarà preferito più ampio range di inclinazione)                                                                                                                           | -20<br>+90 gradi | 1    | -20<br>+90 gradi                        | 1    | -20<br>+90 gradi | 1    | -20<br>+90 gradi | 1    |
| *Minima altezza da pavimento                                                                   | max punti 1 (sarà preferito valore inferiore)                                                                                                                                          | 41 cm            | 0    | 28,5 cm                                 | 1    | 34 cm            | 0,56 | 30 cm            | 0,88 |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                         |      |                  |      | 38 cm            | 0,24 |
| DETECTORE                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                  |      |                                         |      |                  |      |                  |      |
| Doppio detettore avente almeno le caratteristiche minime richieste per il detettore principale | max punti 7,5 (SI = 7,5 per fornitura secondo detettore con specifiche tecniche di matrice, pixel, DQE identiche o superiori a quelle di minima del primo detettore richiesto; NO = 0) | SI               | 7,5  | SI                                      | 7,5  | SI               | 7,5  | SI               | 7,5  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| CONSOLE DI COMANDO E SISTEMA DI ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE                                                                               |                                                                                  |               |      |             |      |             |      |            |     |             |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|-----|-------------|------|--|
| *Matrice                                                                                                                                | max punti 2 (saranno preferite risoluzione e profondità superiori)               | 3320x 3408    | 0    | 3524 x 4288 | 0,42 | 3320 x 3408 | 0    | 4288 x4288 | 2   | 3550 x 4320 | 0,47 |  |
| *Pixel della matrice con dimensioni non superiori a 140 µm                                                                              | max punti 4 (saranno preferite dimensioni inferiori)                             | 125 µm        | 0    | 100 µm      | 4    | 125 µm      | 0    | 100 µm     | 4   | 100 µm      | 4    |  |
| *Efficienza di rivelazione DQE non inferiore al 60%                                                                                     | max punti 3 (sarà prediletta maggiore efficienza)                                | 74%           | 2,7  | 75%         | 3    | 65%         | 0    | 75%        | 3   | 75%         | 3    |  |
| *Peso                                                                                                                                   | max punti 1 (sarà prediletta maggiore leggerezza)                                | 2,3 kg        | 1    | 3,2 kg      | 0,4  | 3,7 kg      | 0,06 | 3,8 kg     | 0   | 3,8 kg      | 0    |  |
| CONSOLE DI COMANDO E SISTEMA DI ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE                                                                               |                                                                                  |               |      |             |      |             |      |            |     |             |      |  |
| *Provista di processore da almeno 8 GB di RAM                                                                                           | max punti 0,5 (sarà preferita maggiore capacità della RAM)                       | 8G            | 0    | 16 G        | 0,5  | 8G          | 0    | 16G        | 0,5 | 8G          | 0    |  |
| *Tempo di preview delle immagini sulla console inferiore a 3 secondi                                                                    | max punti 0,5 (saranno preferite tempistiche ridotte)                            | 1 sec         | 0,5  | < 1 sec     | 0,5  | < 3 sec     | 0    | 1 sec      | 0,5 | 1,5 sec     | 0,37 |  |
| *Tempo di visualizzazione delle immagini definitive sulla console inferiore a 8 secondi                                                 | max punti 0,5 (saranno preferite tempistiche ridotte)                            | 5 sec         | 0,33 | < 6 sec     | 0    | 6 sec       | 0    | 4,5 sec    | 0,5 | 5-15 sec    | 0    |  |
| Possibilità di personalizzare i protocolli                                                                                              | max punti 1 (SI = 1; NO = 0)                                                     | SI            | 1    | SI          | 1    | SI          | 1    | SI         | 1   | SI          | 1    |  |
| Teleradiografo digitale per l'esecuzione di esami radiografici della colonna in toto, del torace e degli arti inferiori in ortostatismo | max punti 5 (SI = 5; NO = 0)                                                     | SI            | 5    | SI          | 5    | SI          | 5    | SI         | 5   | SI          | 5    |  |
| *Dotata di monitor Full HD da almeno 21" per preview e gestione comandi, dotato nativamente di curva di calibrazione                    | max punti 1 (saranno preferite dimensioni superiori e maggior numero di comandi) | 23" + lap top | 0,5  | 24"         | 1    | 24"         | 1    | 24"        | 1   | 23"         | 0    |  |
| Possibilità di eseguire esami con doppia energia                                                                                        | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                     | NO            | 0    | SI          | 2    | NO          | 0    | NO         | 0   | SI          | 2    |  |

A.U. 16

81

Bocconi

Roll

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| Idoneo ad effettuare acquisizioni tomografiche a bassissima dose                                                                          | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                                                                              | SI | 2 | SI | 2 | NO | 0 | NO | 0 | NO | 0 |
| Possibilità di acquisire ed elaborare automaticamente immagini composite per anatomie estese con movimenti automatici del portadettettore | max punti 2 (SI = 2; NO = 0)                                                                                                                                                                                                              | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 |
| *Ulteriori software                                                                                                                       | max punti 2 (sarà preferito maggior numero di software per ottimizzare la diagnostica e ridurre l'esposizione)                                                                                                                            | SI | 2 | SI | 2 | SI | 2 | SI | 1 | SI | 1 |
| *Fornitura, installazione e pose in opera del sistema                                                                                     | max punti 7 (sarà valutato il progetto presentato con particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rifacimento pavimento;</li> <li>Rifacimento controsoffitto;</li> <li>Sostituzione del quadro elettrico)</li> </ul> |    | 6 |    | 7 |    | 6 |    | 4 |    | 6 |

Servizio di Assistenza post-vendita (10 punti su 70)

|                                                                                   |               |                   |      |                        |      |                  |      |                        |      |                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------|------------------------|------|------------------|------|------------------------|------|------------------|------|
| Estensione del periodo di garanzia oltre quanto richiesto da capitolato (12 mesi) | max 3 punti   | Ottimo<br>38 mesi | 3    | sufficiente<br>14 mesi | 0,75 | Buono<br>24 mesi | 2,25 | Ottimo<br>36 mesi      | 3    | Buono<br>26 mesi | 2,25 |
| Tempo di intervento dalla ricezione della chiamata                                | max 2 punti   | Discreto<br>4 h   | 1    | Ottimo<br>15 minuti    | 2    | Buono<br>2 h     | 1,5  | Sufficiente<br>8 h     | 0,5  | Buono<br>1 h     | 1,5  |
| Tempo di risoluzione guasto, dalla ricezione della chiamata                       | max 2,5 punti | Buono<br>16 h     | 1,87 | Ottimo<br>12 h         | 2,5  | Buono<br>16 h    | 1,87 | Sufficiente<br>16/24 h | 0,62 | Ottimo<br>12 h   | 2,5  |
| Servizio di assistenza tecnica da remoto mediante connessione da remoto           | max 2,5 punti | Ottimo            | 2,5  | Ottimo                 | 2,5  | Ottimo           | 2,5  | Ottimo                 | 2,5  | Ottimo           | 2,5  |

Totale 54,35 Totale 61,94 Totale 46,18 Totale 55,30 Totale 56,53

Al. 17

| LOTTO N. 1 - AUDIOMETRO CLINICO |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| DITTA                           | QUALITA'<br>(max 70 punti) |  |
| INVENTIS S.r.l.                 | 57,25                      |  |
| NATUS MEDICAL S.r.l.            | 51,50                      |  |
| M.P.S. S.r.l.                   | non<br>ammessa             |  |

| LOTTO N. 2 - IMPEDENZIMETRO CLINICO |                            |  |
|-------------------------------------|----------------------------|--|
| DITTA                               | QUALITA'<br>(max 70 punti) |  |
| INVENTIS S.r.l.                     | 56,37                      |  |
| NATUS MEDICAL S.r.l.                | 52,75                      |  |
| M.P.S. S.r.l.                       | non<br>ammessa             |  |

| LOTTO N. 3 - VIDEONISTAGMOGRAFO |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| DITTA                           | QUALITA'<br>(max 70 punti) |  |
| INVENTIS S.r.l.                 | 52,50                      |  |

| LOTTO N. 4 - POTENZIALI EVOCATI |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| DITTA                           | QUALITA'<br>(max 70 punti) |  |
| INVENTIS S.r.l.                 | 60,87                      |  |
| NATUS MEDICAL S.r.l.            | 43,50                      |  |

| LOTTO N. 5 - OTOMISSIONI ACUSTICHE CON<br>PRODOTTO I DISTORSIONE |                            |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| DITTA                                                            | QUALITA'<br>(max 70 punti) |  |
| INVENTIS S.r.l.                                                  | 33,00                      |  |
| NATUS MEDICAL S.r.l.                                             | 47,75                      |  |

| LOTTO N. 6 - TRAPANO CHIRURGICO |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| DITTA                           | QUALITA'<br>(max 70 punti) |  |
| MEDTRONIC ITALIA S.p.A.         | 66,00                      |  |
| OLYMPUS ITALIA S.r.l.           | 64,25                      |  |
| STRYKER ITALIA S.r.l.           | 60,00                      |  |
| QUERRE ZIBU S.r.l.              | 60,50                      |  |
| VE DI SE HOSPITAL S.p.A.        | 59,00                      |  |

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*  
Boerel 82

46.17

83

Berati

| LOTTO N. 7 - LASER CHIRURGICO |                         |       |
|-------------------------------|-------------------------|-------|
| DITTA                         | QUALITA' (max 70 punti) |       |
| DEKA M.E.L.A. S.r.l.          |                         | 38,50 |

| LOTTO N. 8 - SISTEMA DI VIDEOSCOPIA AMBULATORIALE PER ORL |                         |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| DITTA                                                     | QUALITA' (max 70 punti) |       |
| OLYMPUS S.r.l.                                            |                         | 55,24 |
| QUEFFE 2000 S.r.l.                                        |                         | 60,49 |

| LOTTO N. 9 - SISTEMA riunito da visita ORL |                         |       |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------|
| DITTA                                      | QUALITA' (max 70 punti) |       |
| VE DI SE HOSPITAL S.p.A.                   |                         | 40,37 |

| LOTTO N. 10 - OTALMOSCOPIO BINOCULARE INDIRETTO |                         |       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| DITTA                                           | QUALITA' (max 70 punti) |       |
| TEC MED S.r.l.                                  |                         | 50,87 |
| MEDIKA VISION S.r.l.                            |                         | 45,50 |
| OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.r.l.                  |                         | 54,37 |
| BIOPHISICA S.r.l.                               |                         | 57,00 |

| LOTTO N. 11 - CAMPIMETRO       |                         |       |
|--------------------------------|-------------------------|-------|
| DITTA                          | QUALITA' (max 70 punti) |       |
| CARL ZEISS S.p.A.              |                         | 50,18 |
| TEC MED S.r.l.                 |                         | 46,32 |
| OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.r.l. |                         | 59,74 |
| BIOPHISICA S.r.l.              |                         | 45,75 |

| LOTTO N. 12 - OTTO TIPO A PROIEZIONE |                         |       |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|
| DITTA                                | QUALITA' (max 70 punti) |       |
| TEC MED S.r.l.                       |                         | 52,23 |
| MEDIKA VISION S.r.l.                 |                         | 46,30 |
| OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.r.l.       |                         | 46,95 |
| BIOPHISICA S.r.l.                    |                         | 54,30 |

Pace

10/10

2

| LOTTO N. 13 - FRONTOFOCIMETRO     |                             |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| DITTA                             | QUANTITA'<br>(max 10 punti) |  |
| CARL ZEISS S.p.A.                 | 51,87                       |  |
| TEC MED S.r.l.                    | 54,57                       |  |
| MEDIKA VISION S.r.l.              | 37,05                       |  |
| OPTARISTON<br>OPTALMOLOGIA S.r.l. | 57,19                       |  |
| BIOPHISICA S.r.l.                 | 44,83                       |  |

| LOTTO N. 14 - AUTOREFRATTOMETRO CON<br>CHERATOMETRIA |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| GIITA                                                | QUALITA'<br>(max 70 punti) |
| TEC MED S.r.l.                                       | 50,44                      |
| MIEDHKA VISION S.r.l.                                | 48,89                      |
| OPTARISTON<br>OFTHALMOLOGIA S.r.l.                   | 51,37                      |
| BIOPHISICA S.r.l.                                    | 50,25                      |

| LOTTO N. 15 - MICROSCOPIO OPERATORIO |                             |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|
| DITTA                                | QUALIFICA<br>(max 70 punti) |       |
| CARL ZEISS S.p.A.                    |                             | 60,86 |
| LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.            |                             | 57,85 |
| TEC MED. S.r.l.                      |                             | 35,84 |
| OPTARISTON<br>OPTALMOLOGIA S.r.l.    |                             | 39,34 |

| LOTTO N. 16 - SISTEMA RADIOLOGICO<br>DIRETTOMULTIFUNZIONE |  | QUALITA'<br>(max 70 punti) |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| DITTA                                                     |  |                            |
| GENERAL MEDICAL MERATE<br>S.p.A.                          |  | 54,35                      |
| GE MEDICAL SYSTEMS<br>ITALIA S.p.A.                       |  | 61,94                      |
| METALTRONICA S.p.A.                                       |  | 46,18                      |
| GSM MED S.r.l.                                            |  | 55,30                      |
| TRADE ART 2000 S.p.A.                                     |  | 66,53                      |



Bank

*Bonati*

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
*Ufficio acquisizione attrezzature – beni – comodati*

**Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014.**

### **VERBALE N. 1**

Il giorno 19.11.2020 alle ore 11,00 il Presidente della Commissione, nominata con deliberazione n. 1472 del 16.10.2020, Dott. Alberto Rocco, in seduta pubblica attivata in modalità virtuale attraverso la Piattaforma STELLA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), procede all'apertura e al controllo della regolarità della documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla gara a Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A.O. San Camillo Forlanini. Finanziamento DGR 695 del 21/10/2014, indetta con deliberazione n. 1574 del 21.11.2020.

La Commissione riunita è così composta:

**PRESIDENTE** Dott. Alberto Rocco – Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria  
**COMPONENTE** Dott. Ottavio Bonati – Dirigente Medico U.O.S.D. Oculistica  
**COMPONENTE** Dott. Michele Galluzzo – Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini in urgenza ed emergenza

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Laura Giusti – Collaboratore Amministrativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il Presidente prende altresì atto delle offerte pervenute da parte delle Seguenti Ditte:

| <b>Ragione Sociale</b>            | <b>lotti</b>      |
|-----------------------------------|-------------------|
| DEKA M.E.L.A. S.R.L.              | 7                 |
| MEDTRONIC ITALIA SPA              | 6                 |
| OLYMPUS ITALIA SRL                | 6,8               |
| INVENTIS                          | 1,2,3,4,5         |
| CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO | 11,13,15          |
| STRYKER ITALIA                    | 6                 |
| GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.     | 16                |
| LEICA MICROSYSTEMS                | 15                |
| GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.  | 16                |
| NATUS MEDICAL SRL                 | 1,2,4,5           |
| TEC MED S.r.l.                    | 10,11,12,13,14,15 |
| METALTRONICA                      | 16                |
| DUEFFE 2000 Srl                   | 6,8               |

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 – 2589 – fax: 06 55552603

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| GMS MED                    | 16                |
| MEDIKA VISION UNIPERSONALE | 10,12,13,14       |
| OPTARISTON OFTALMOLOGIA    | 10,11,12,13,14,15 |
| VE.DI.SE. Hospital         | 6,9               |
| BIOPHISICA SRL             | 10,11,12,13,14    |
| TRADE ART 2000 S.P.A.      | 16                |
| M.R.S Srl                  | 1,2               |

Il Presidente dà inizio ai lavori provvedendo a sbloccare e scaricare la documentazione tecnica presentata per verificarne la conformità della stessa a quanto richiesto nel disciplinare di gara

Il Presidente alle ore 13,30 termina la seduta pubblica virtuale e si aggiorna al 24.11.2020 per la valutazione delle offerte presentate.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott. Alberto Rocco

COMPONENTE Dott. Ottavio Bonati

COMPONENTE Dott. Michele Galluzzo

SEGRETARIO Sig.ra Laura Giusti



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINIREGIONE  
LAZIO

## U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

## ALLEGATO "ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI"

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione : BSDG 4661 / 2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

## VEDI FINANZIAMENTO DI CUI ALLA NOTA \*

2021

| Aut.                           | Sub | Mod | Progetto | Conto        | Presente<br>prenotazione |
|--------------------------------|-----|-----|----------|--------------|--------------------------|
| 46                             | 1   |     | X016     | 101020405000 | 703.991,95               |
|                                |     |     |          |              |                          |
|                                |     |     |          |              |                          |
| TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE |     |     |          |              | € : 703.991,95           |

| Conto<br>Economico/Patrimoniale | DESCRIZIONE         |
|---------------------------------|---------------------|
| 101020405000                    | MACCHINARI SANITARI |
|                                 |                     |
|                                 |                     |
|                                 |                     |

\*FINANZIAMENTO PER ACQUISIZIONE IN URGENZA DI APPARECCHIATURE DI MEDIA E BASSA TECNOLOGIA NON PIU' UTILIZZABILI PER VETUSTA' ED OBSOLESCENZA TECNOLOGICA -  
ANNUALITA' 2014 D.G.R. 695 DEL 21/10/2014 P.N. 938 DEL 02/02/2015

Data 23/3/2021Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**  
(Firma)